


Region Nordjylland




**Region
Nordjylland**

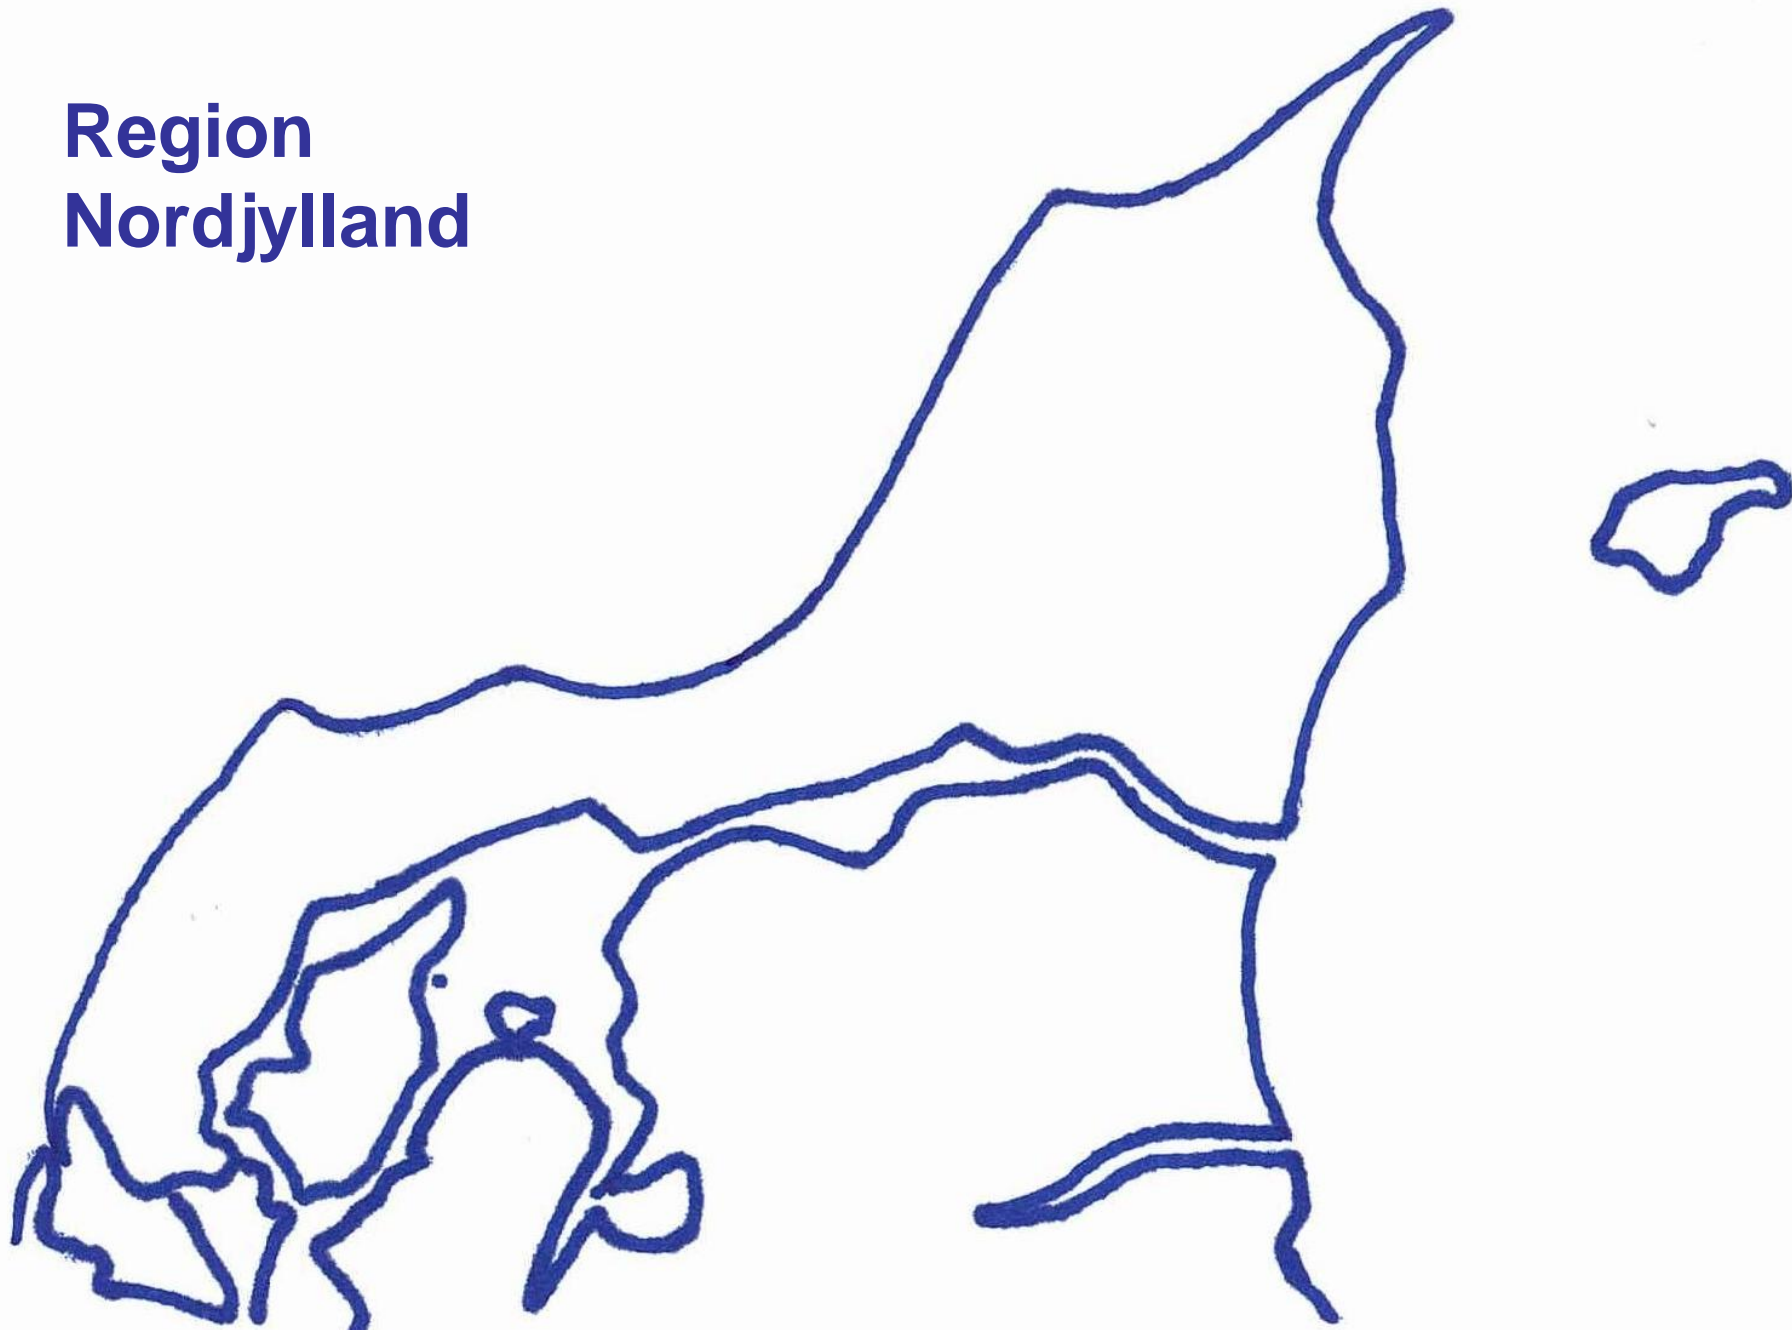


**Region
Nordjylland**




**Region
Nordjylland**

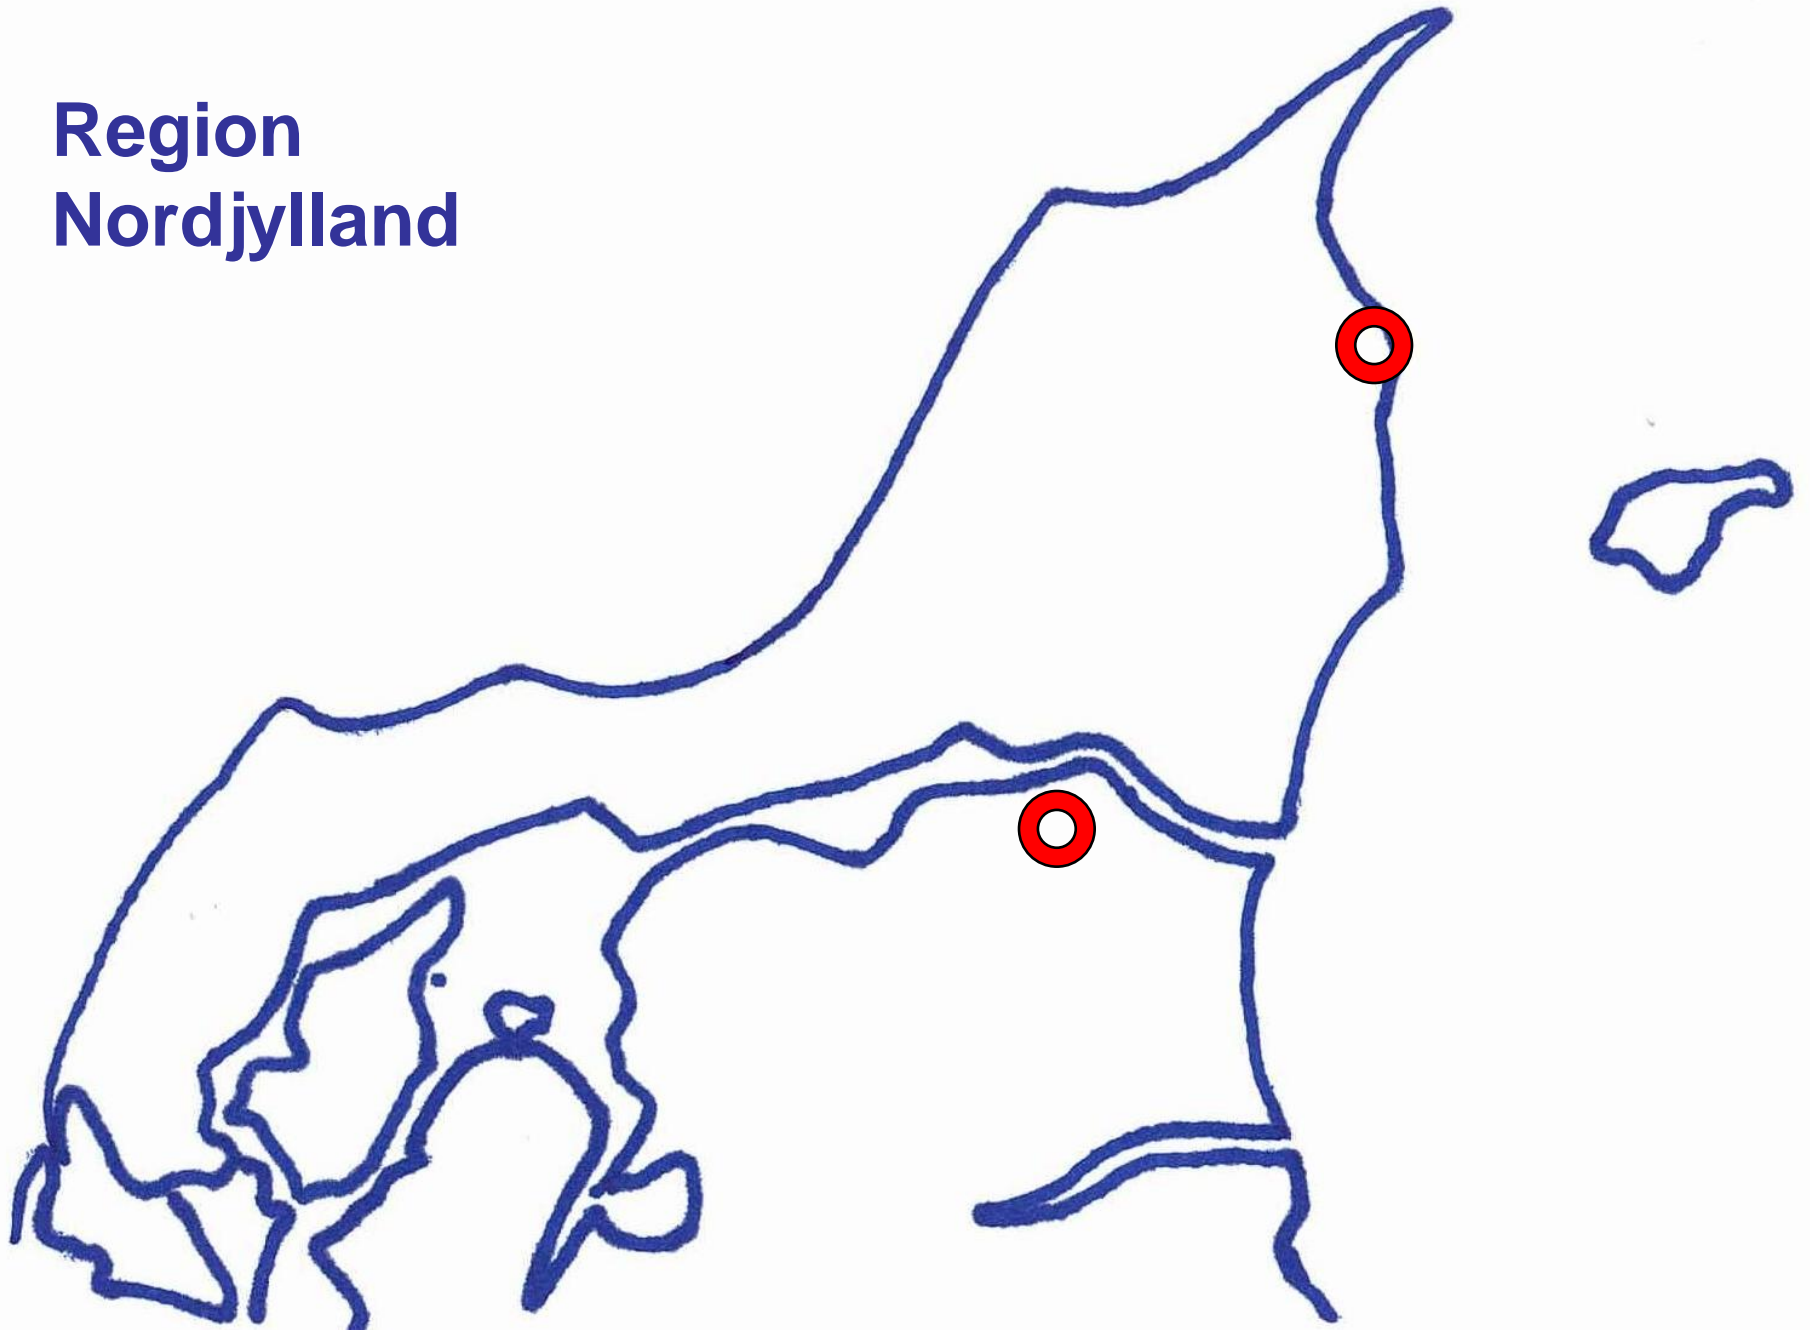


**Region
Nordjylland**

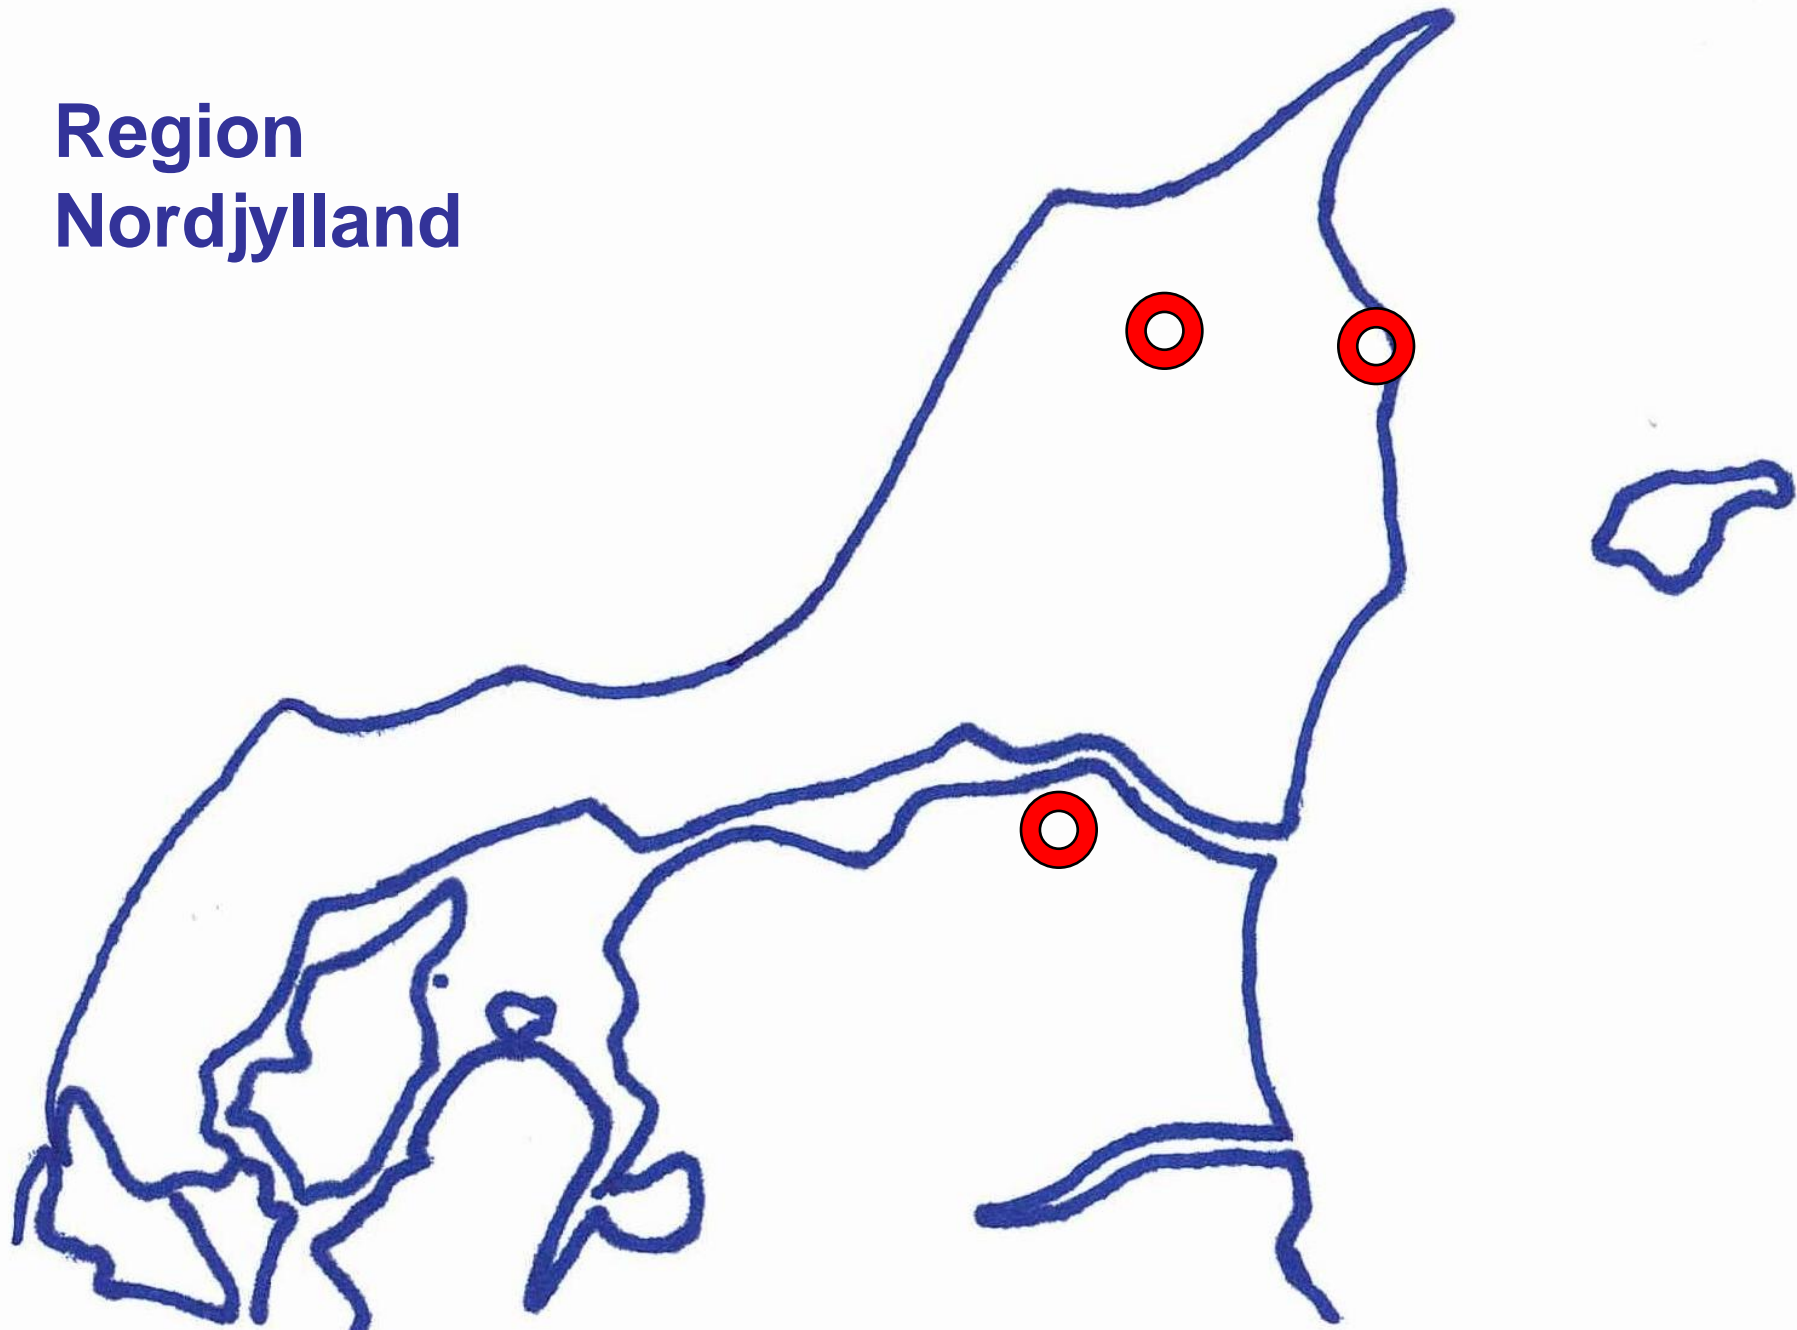


**Region
Nordjylland**

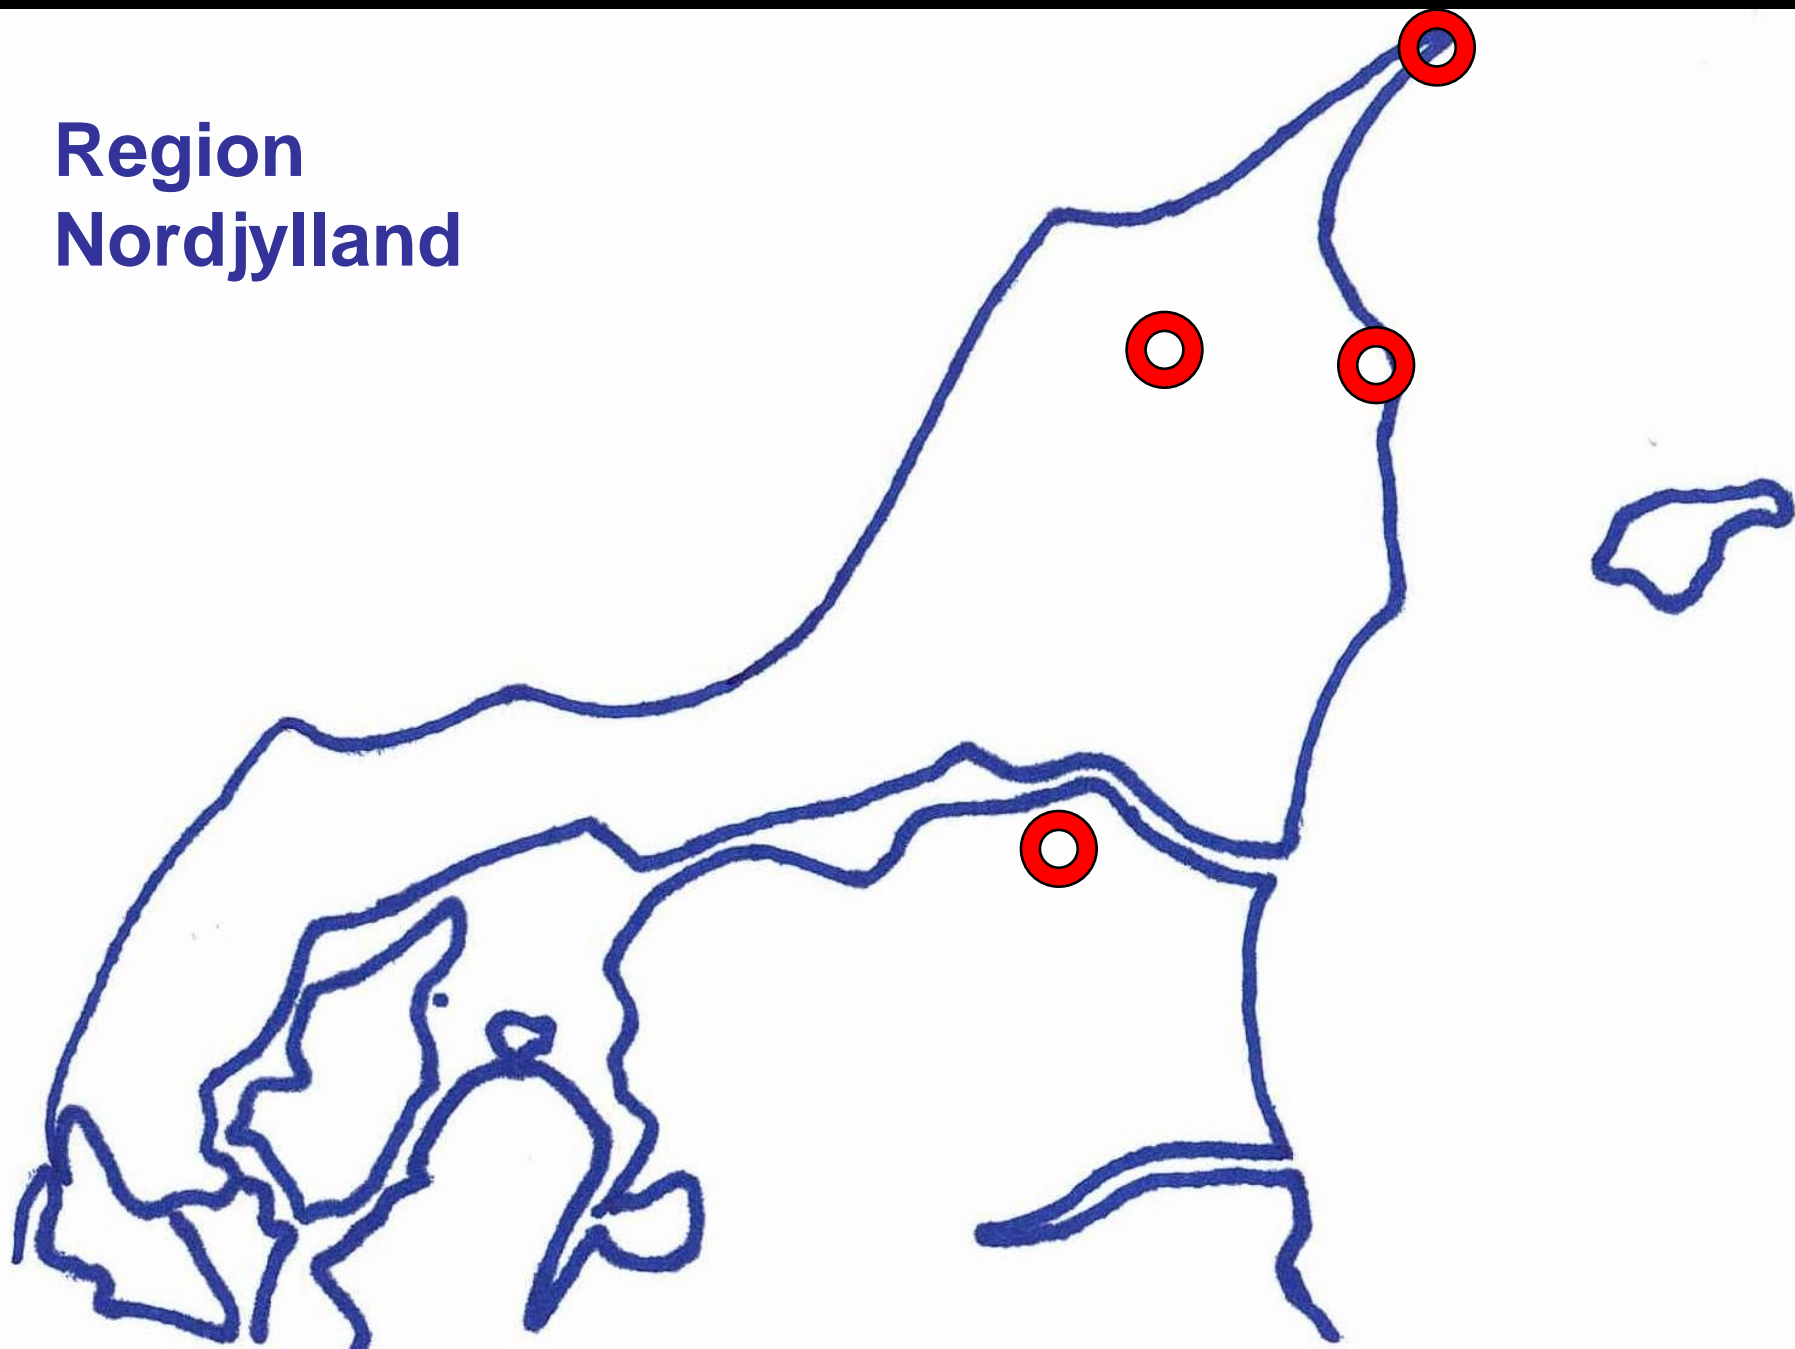


**Region
Nordjylland**

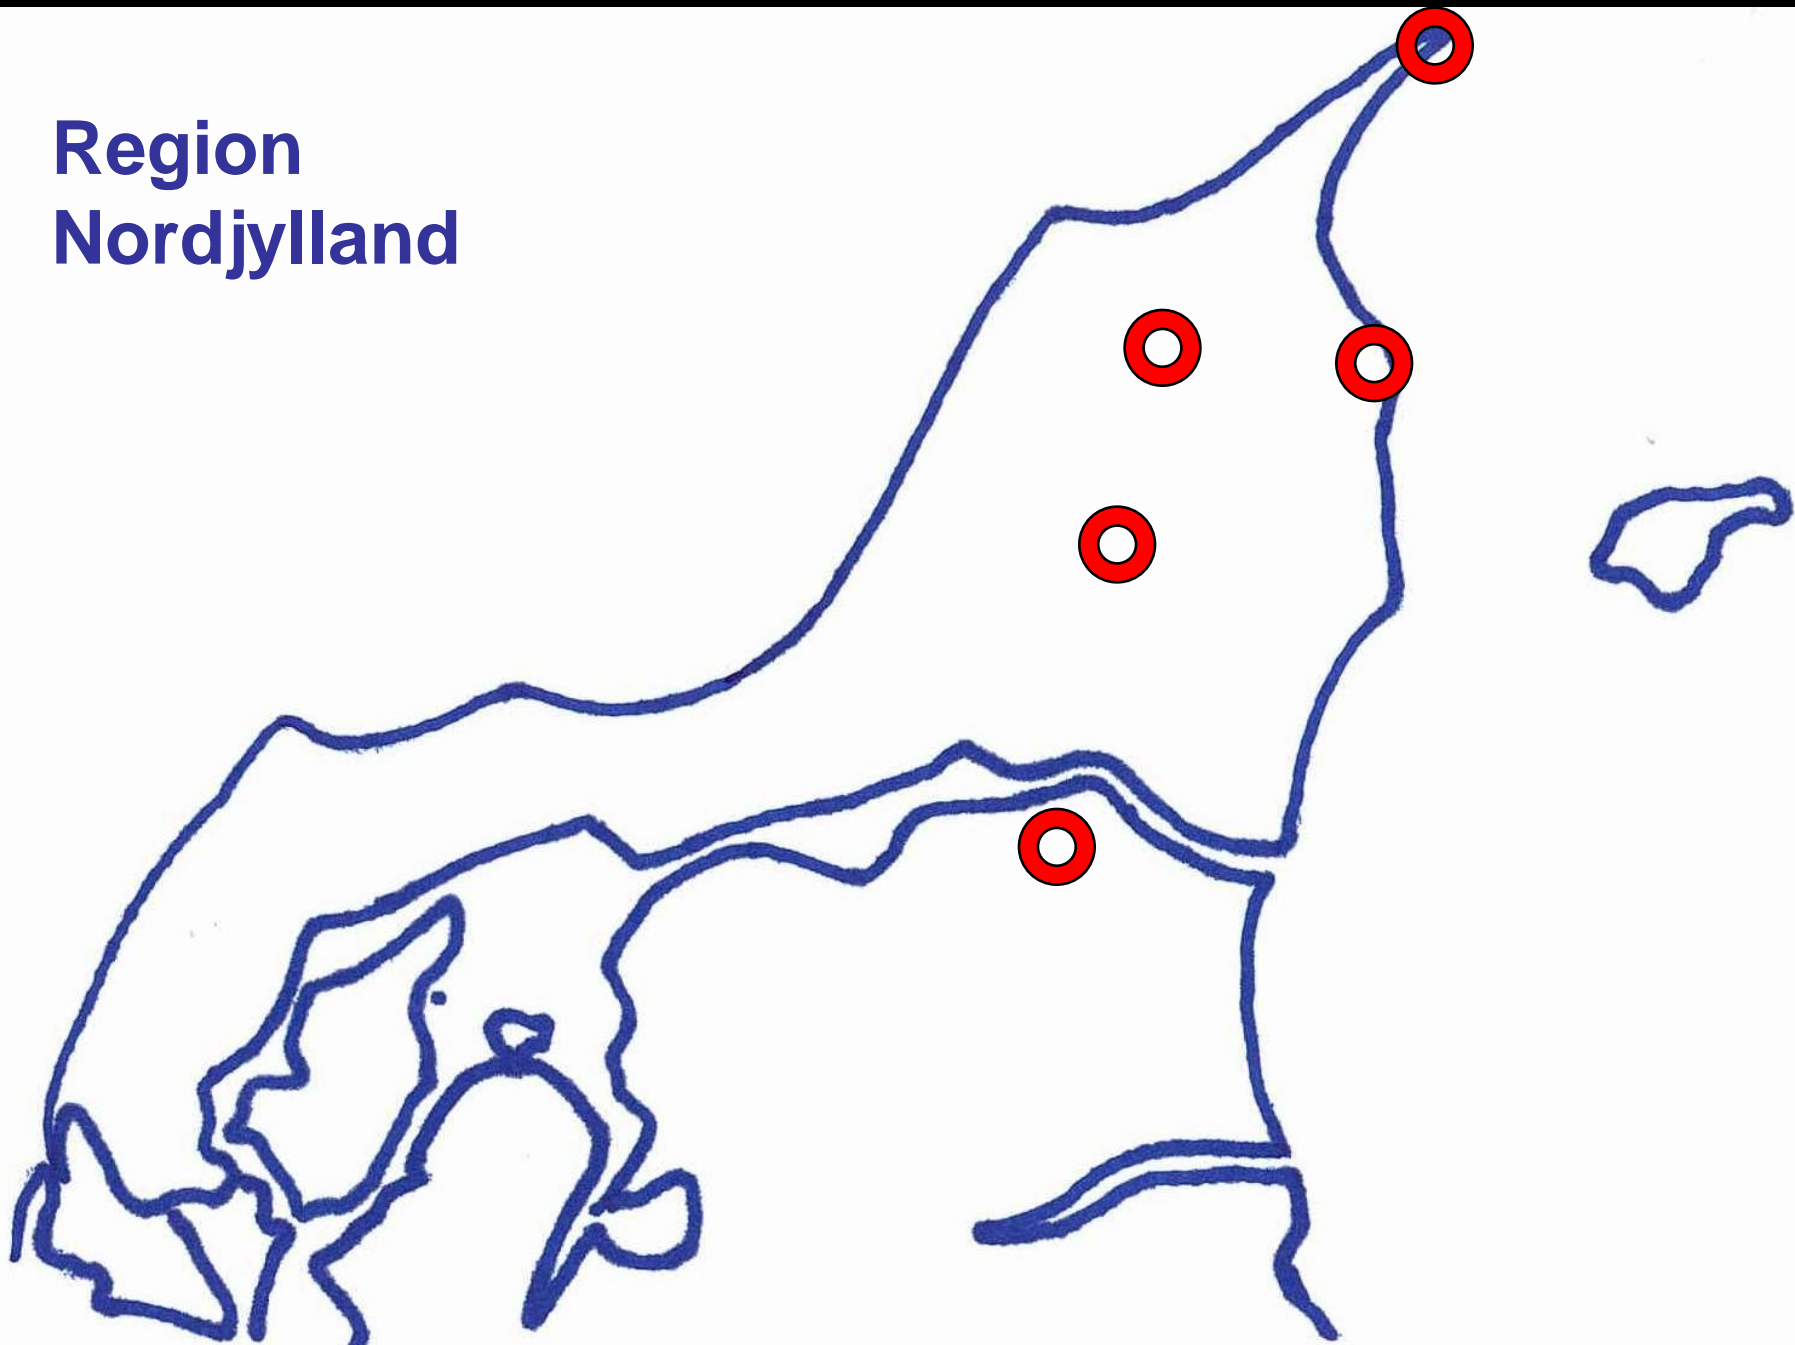


**Region
Nordjylland**

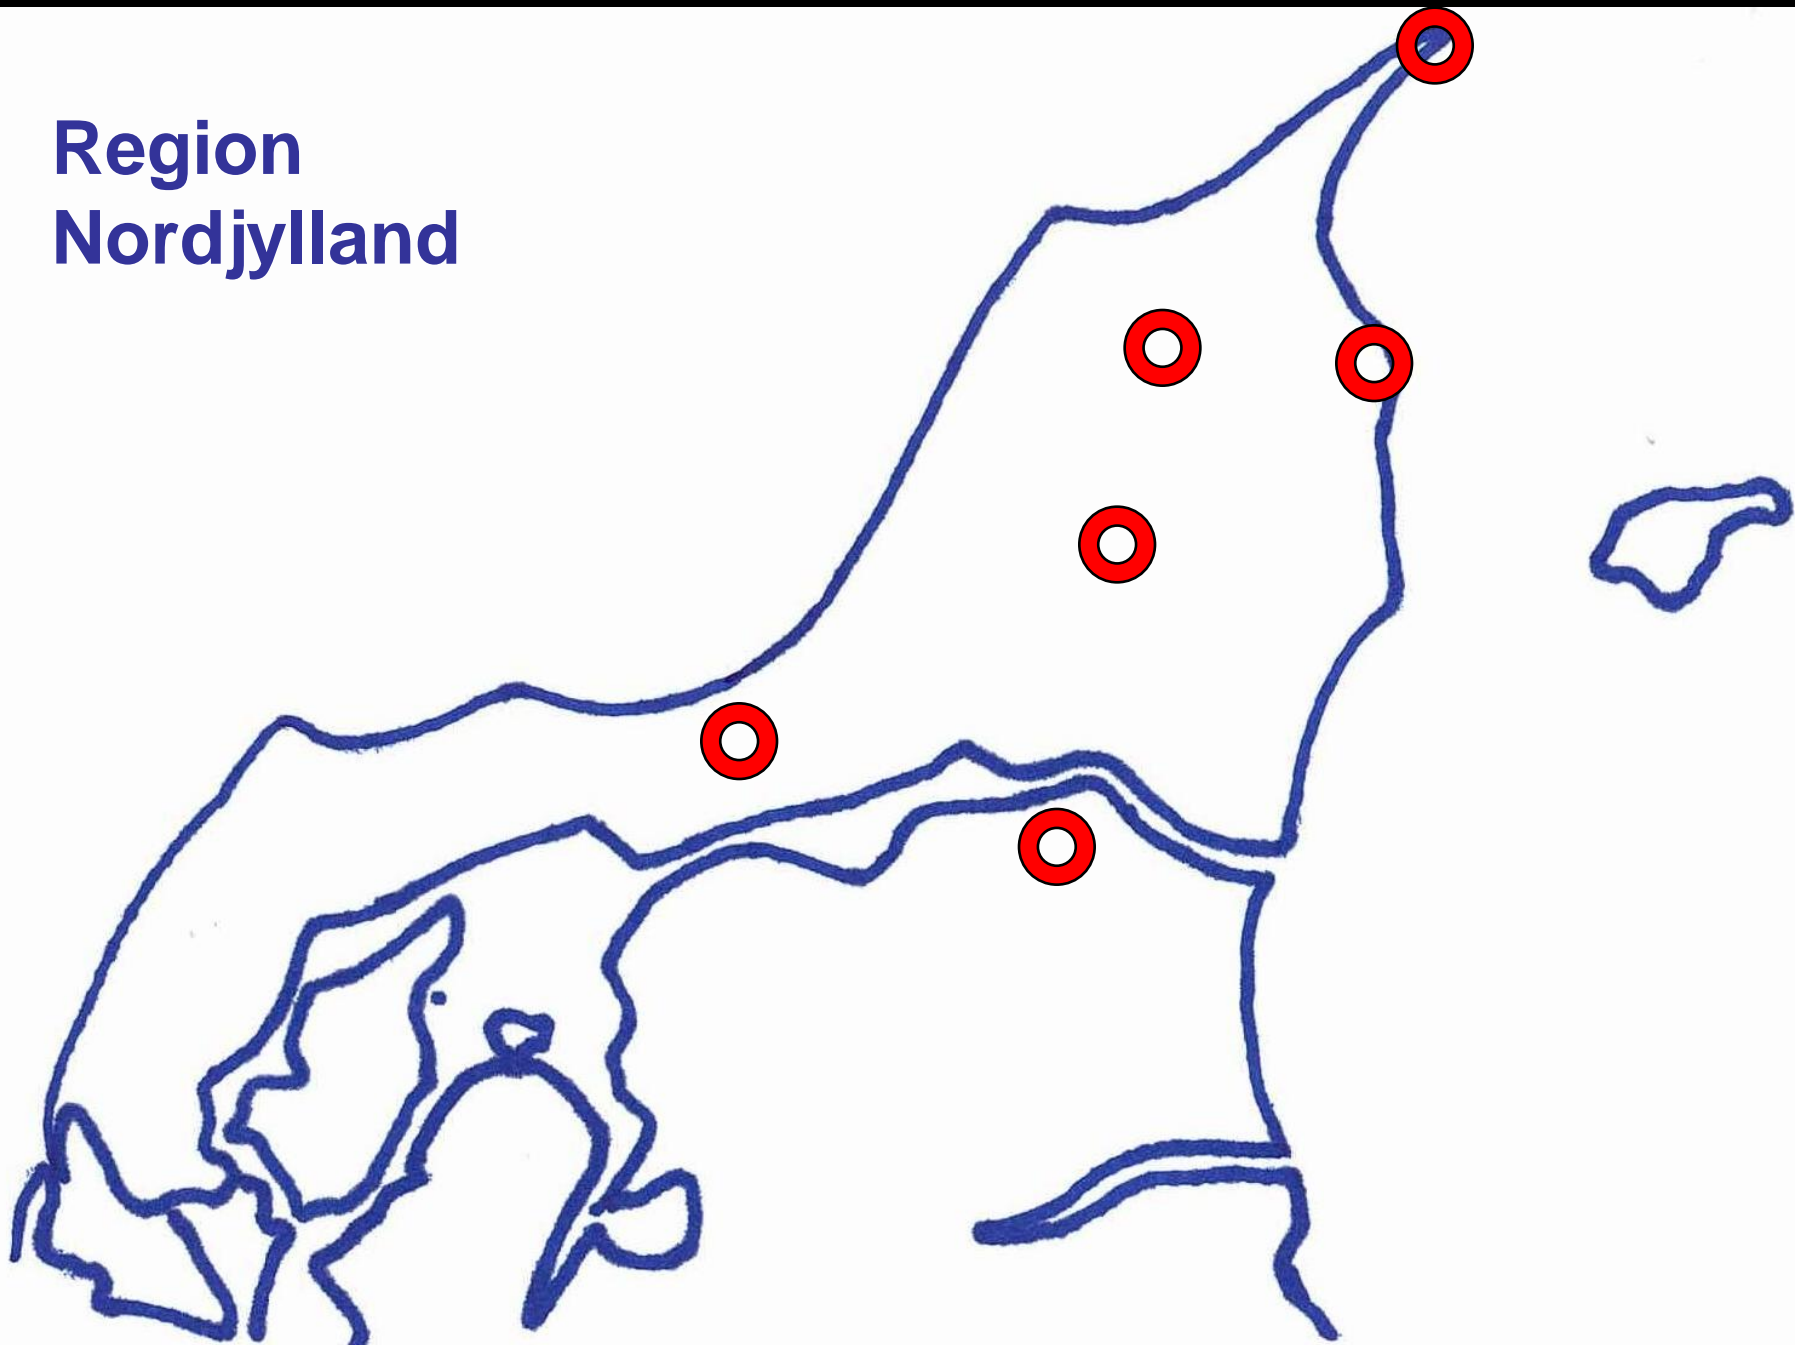


**Region
Nordjylland**

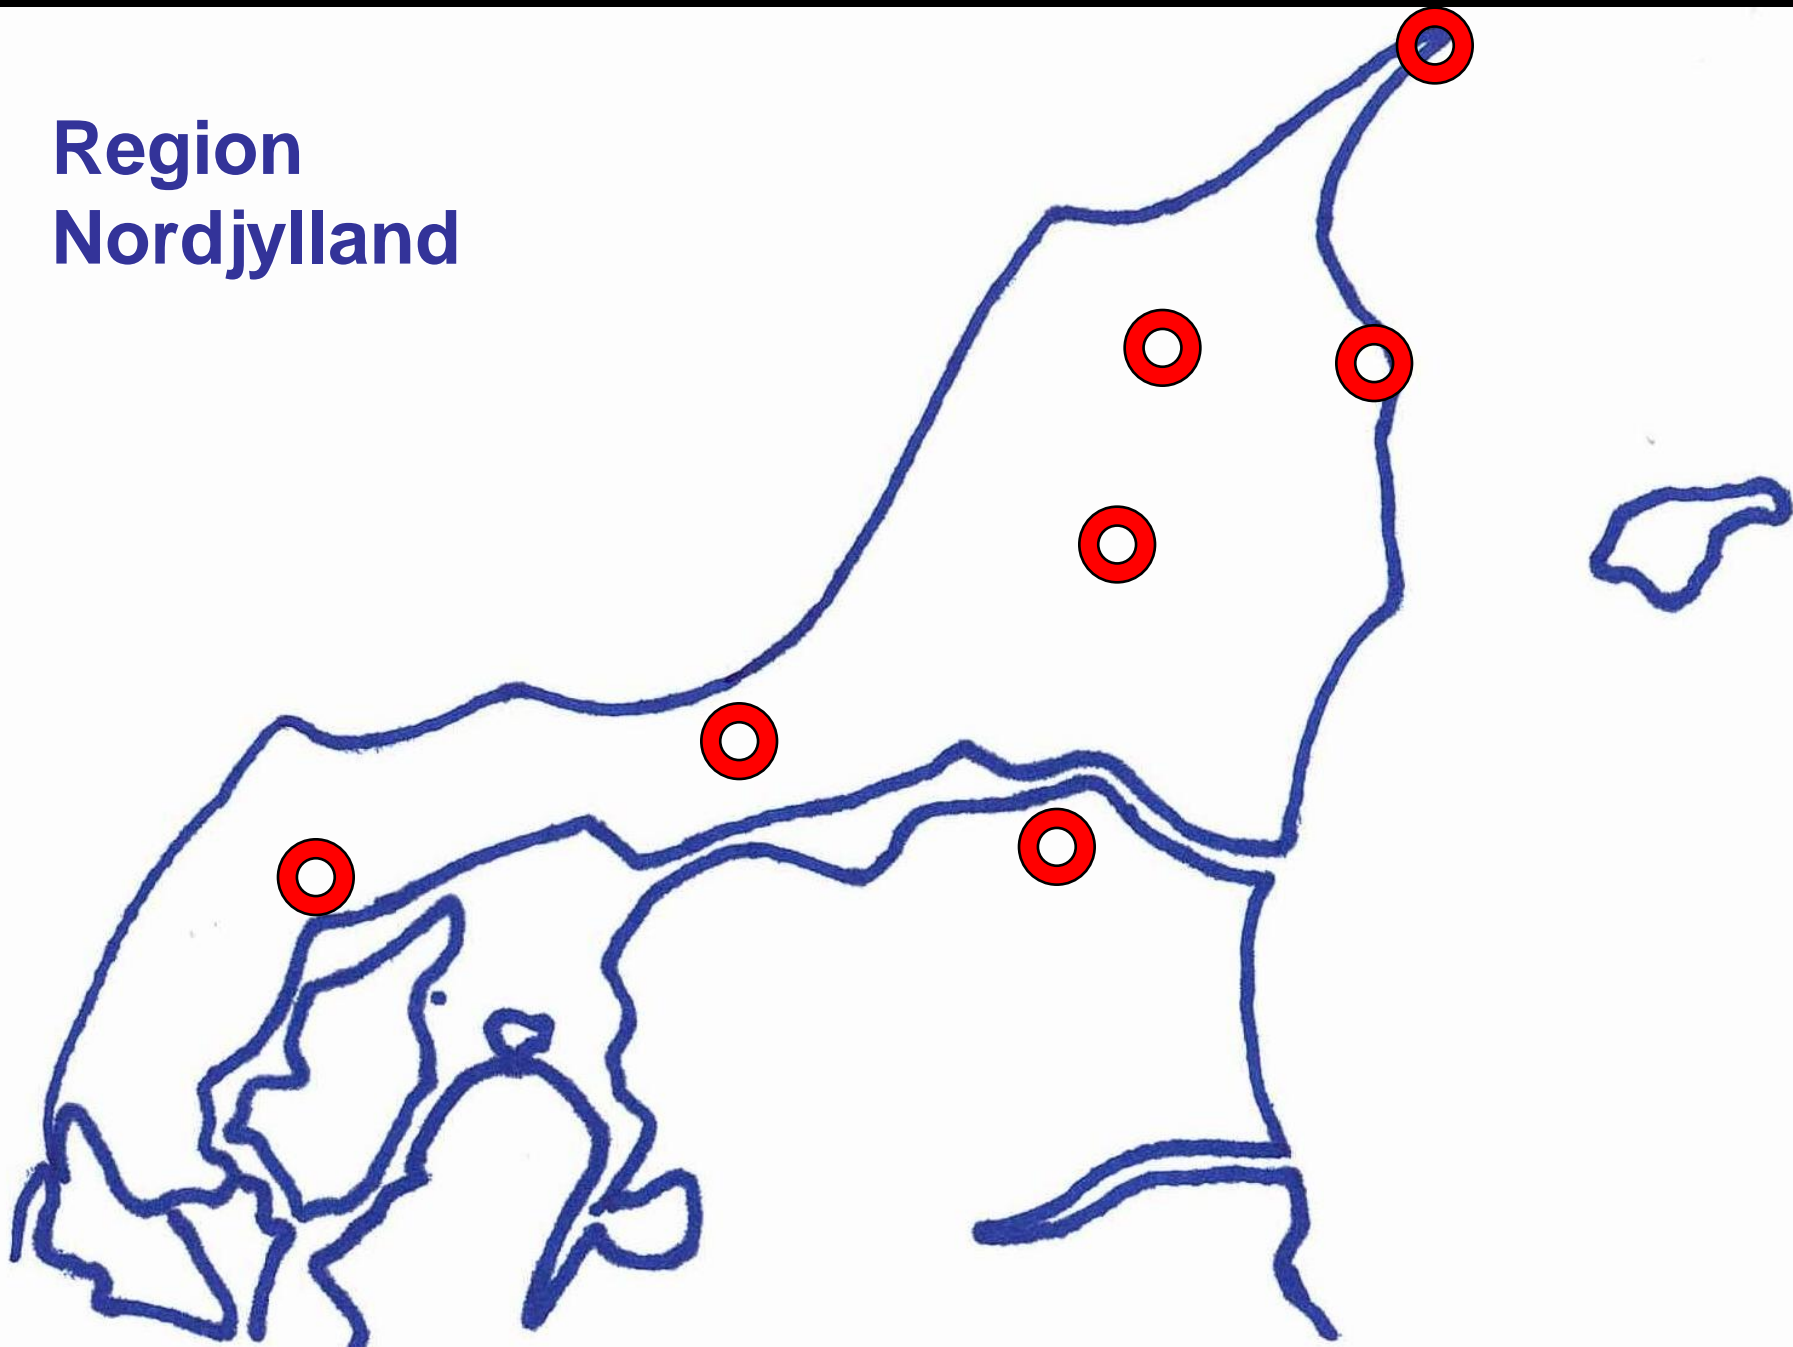


**Region
Nordjylland**

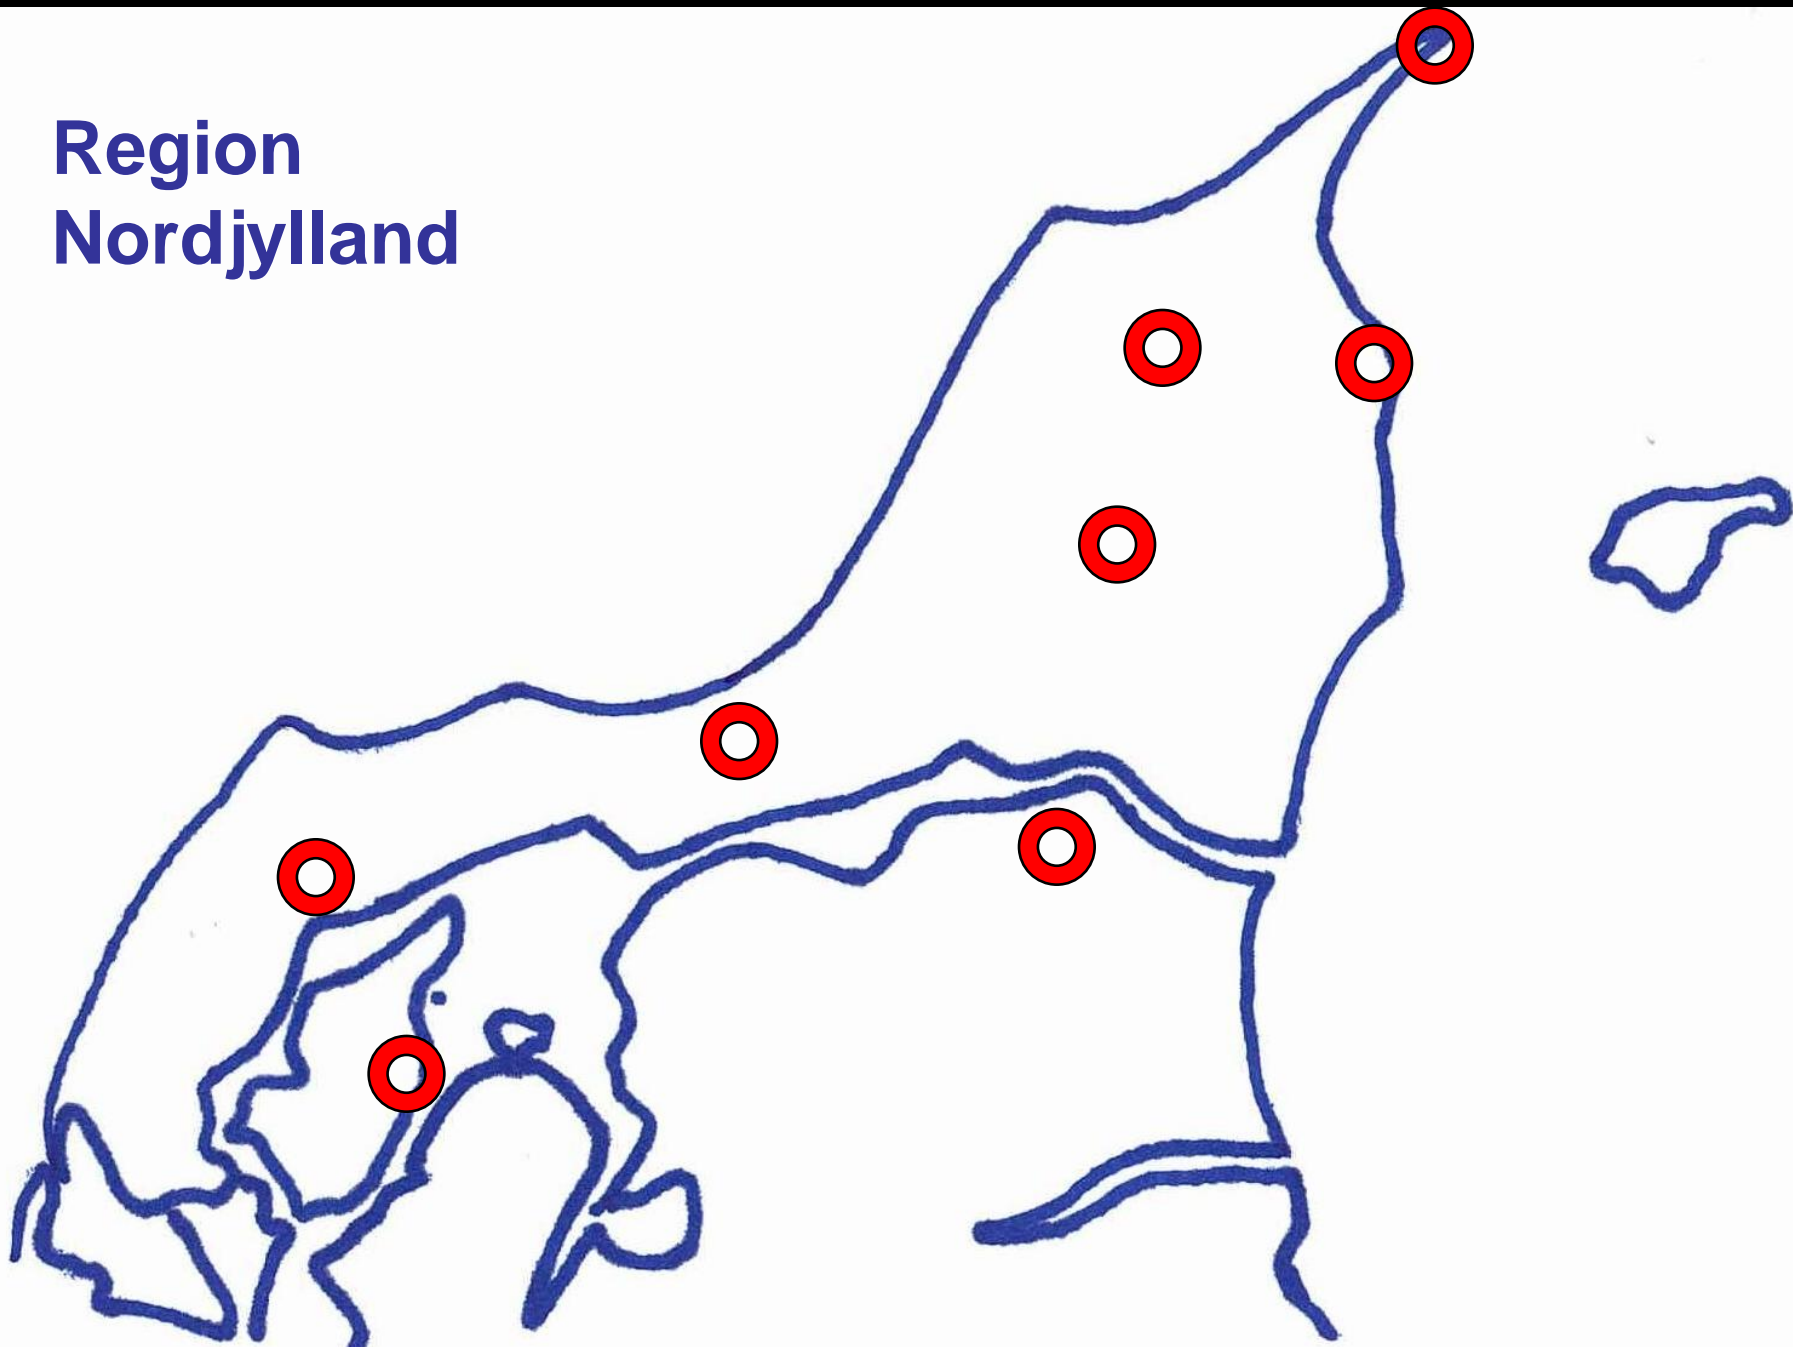


**Region
Nordjylland**

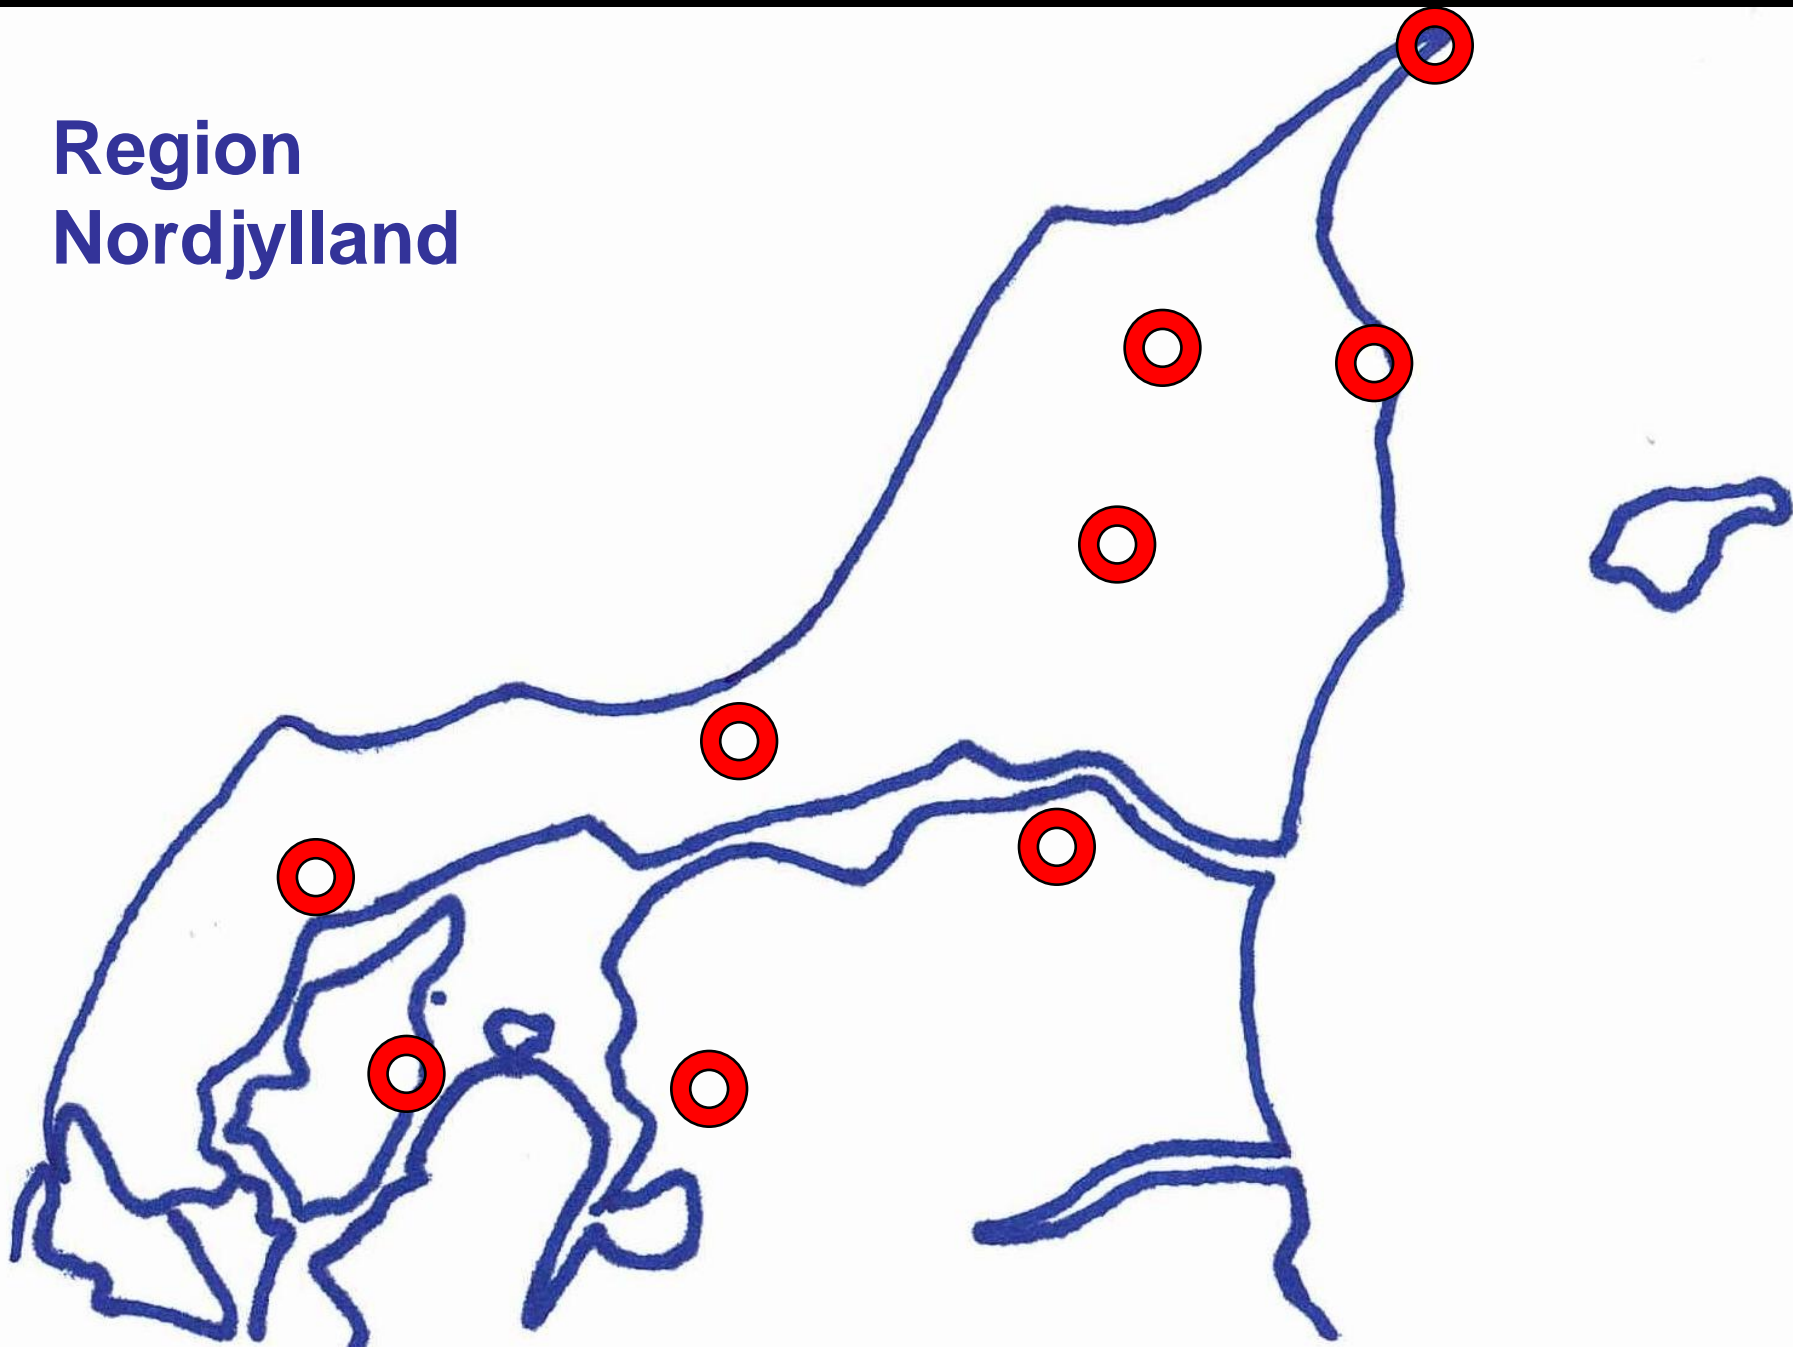


**Region
Nordjylland**

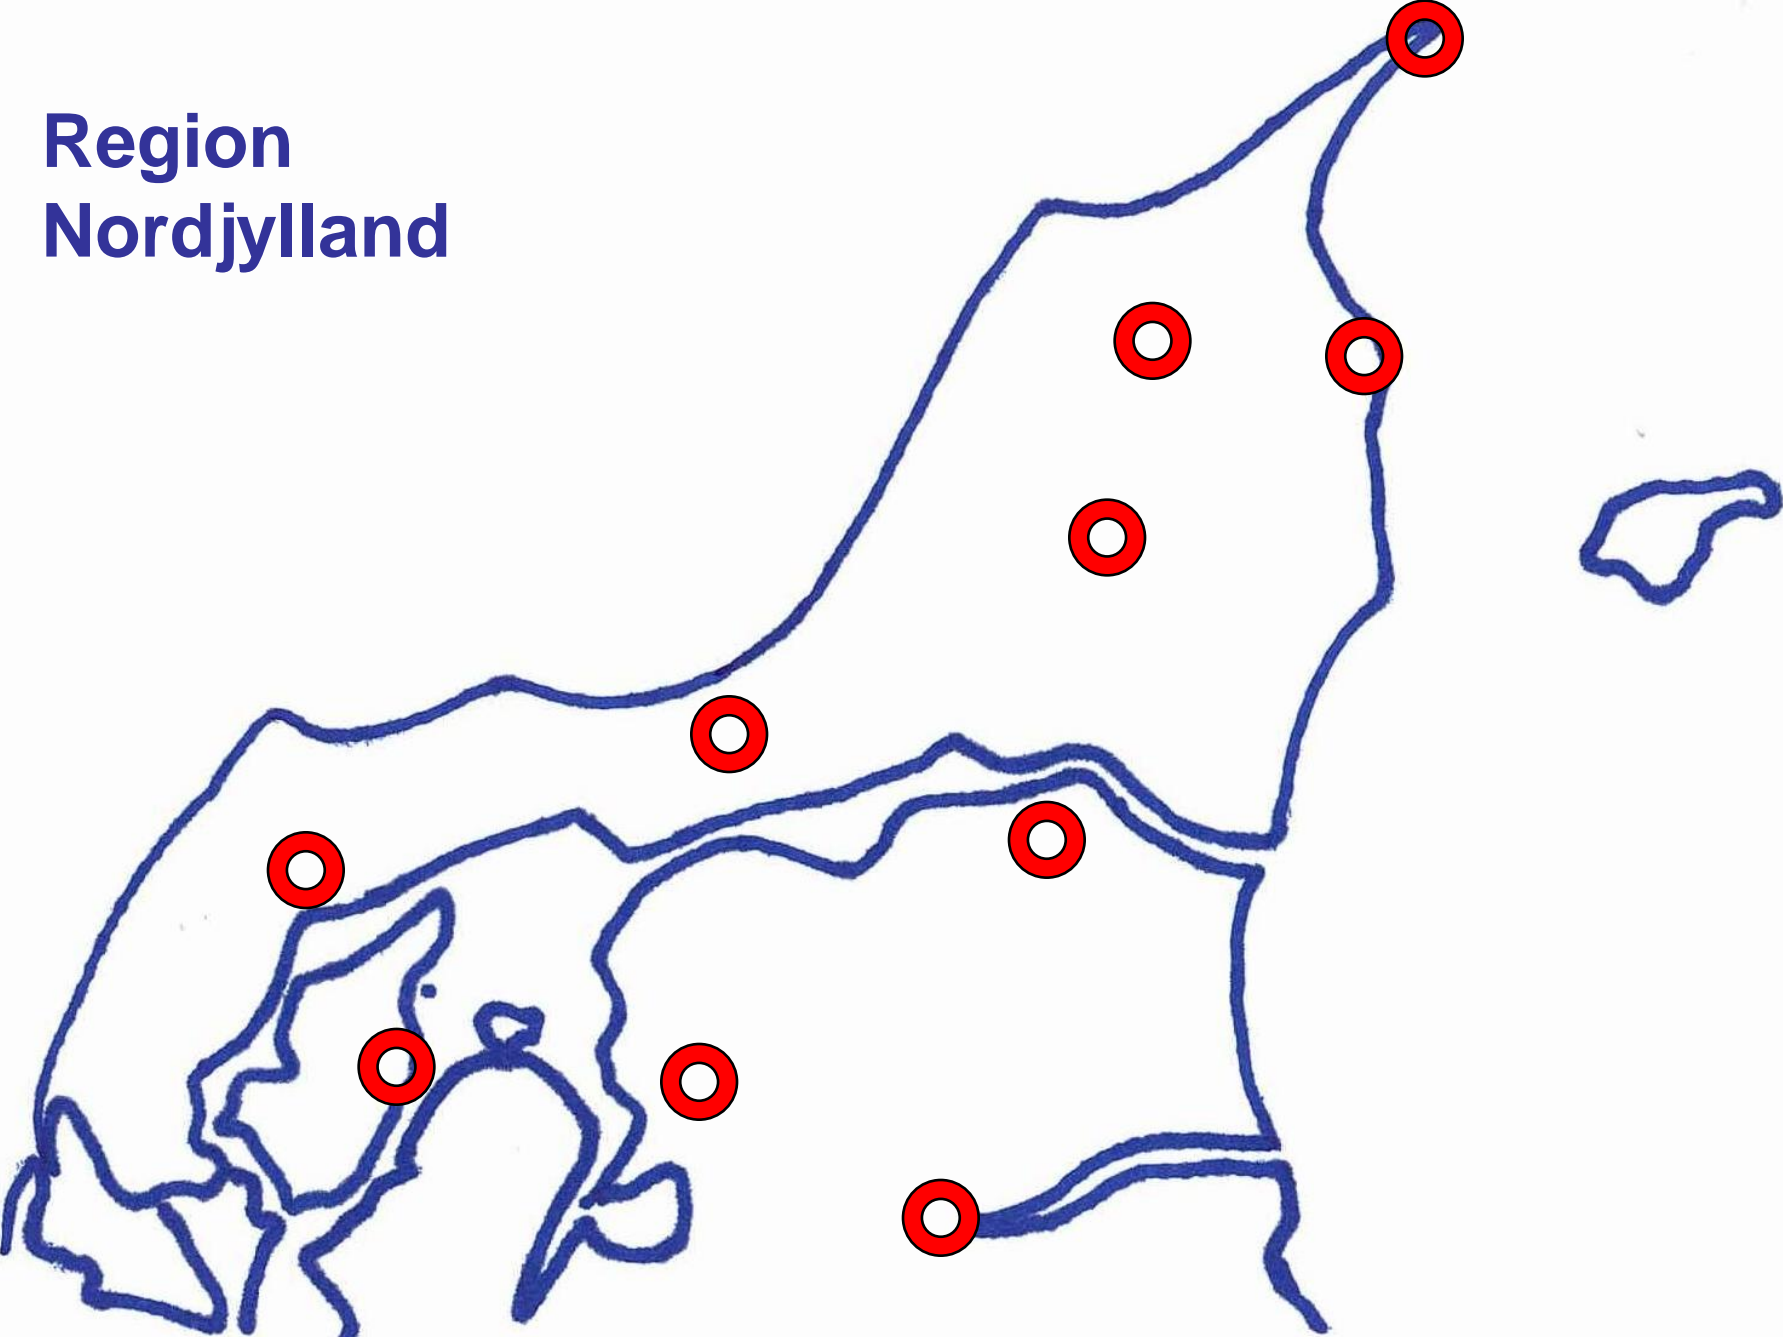


**Region
Nordjylland**

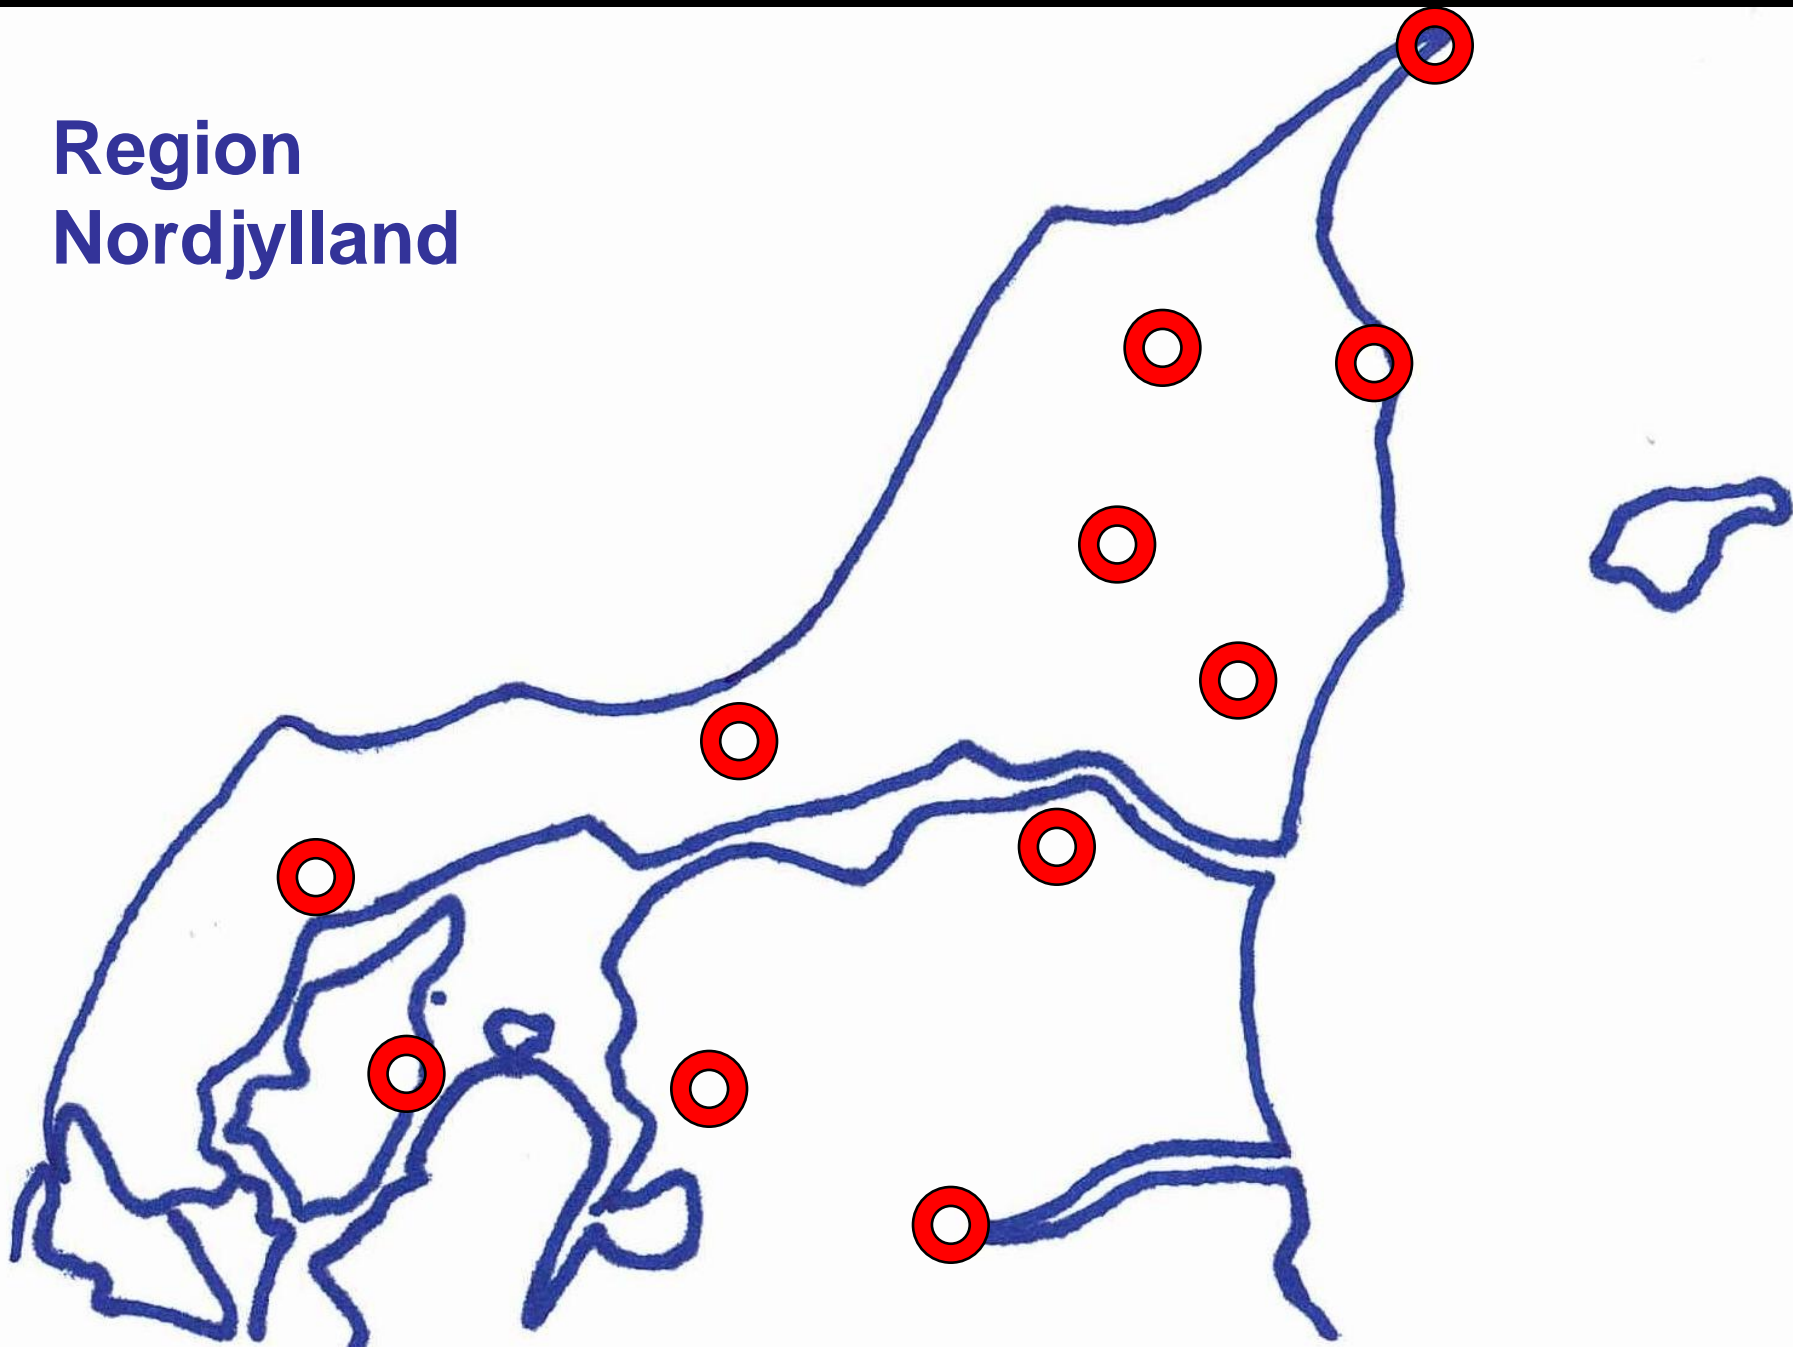


**Region
Nordjylland**

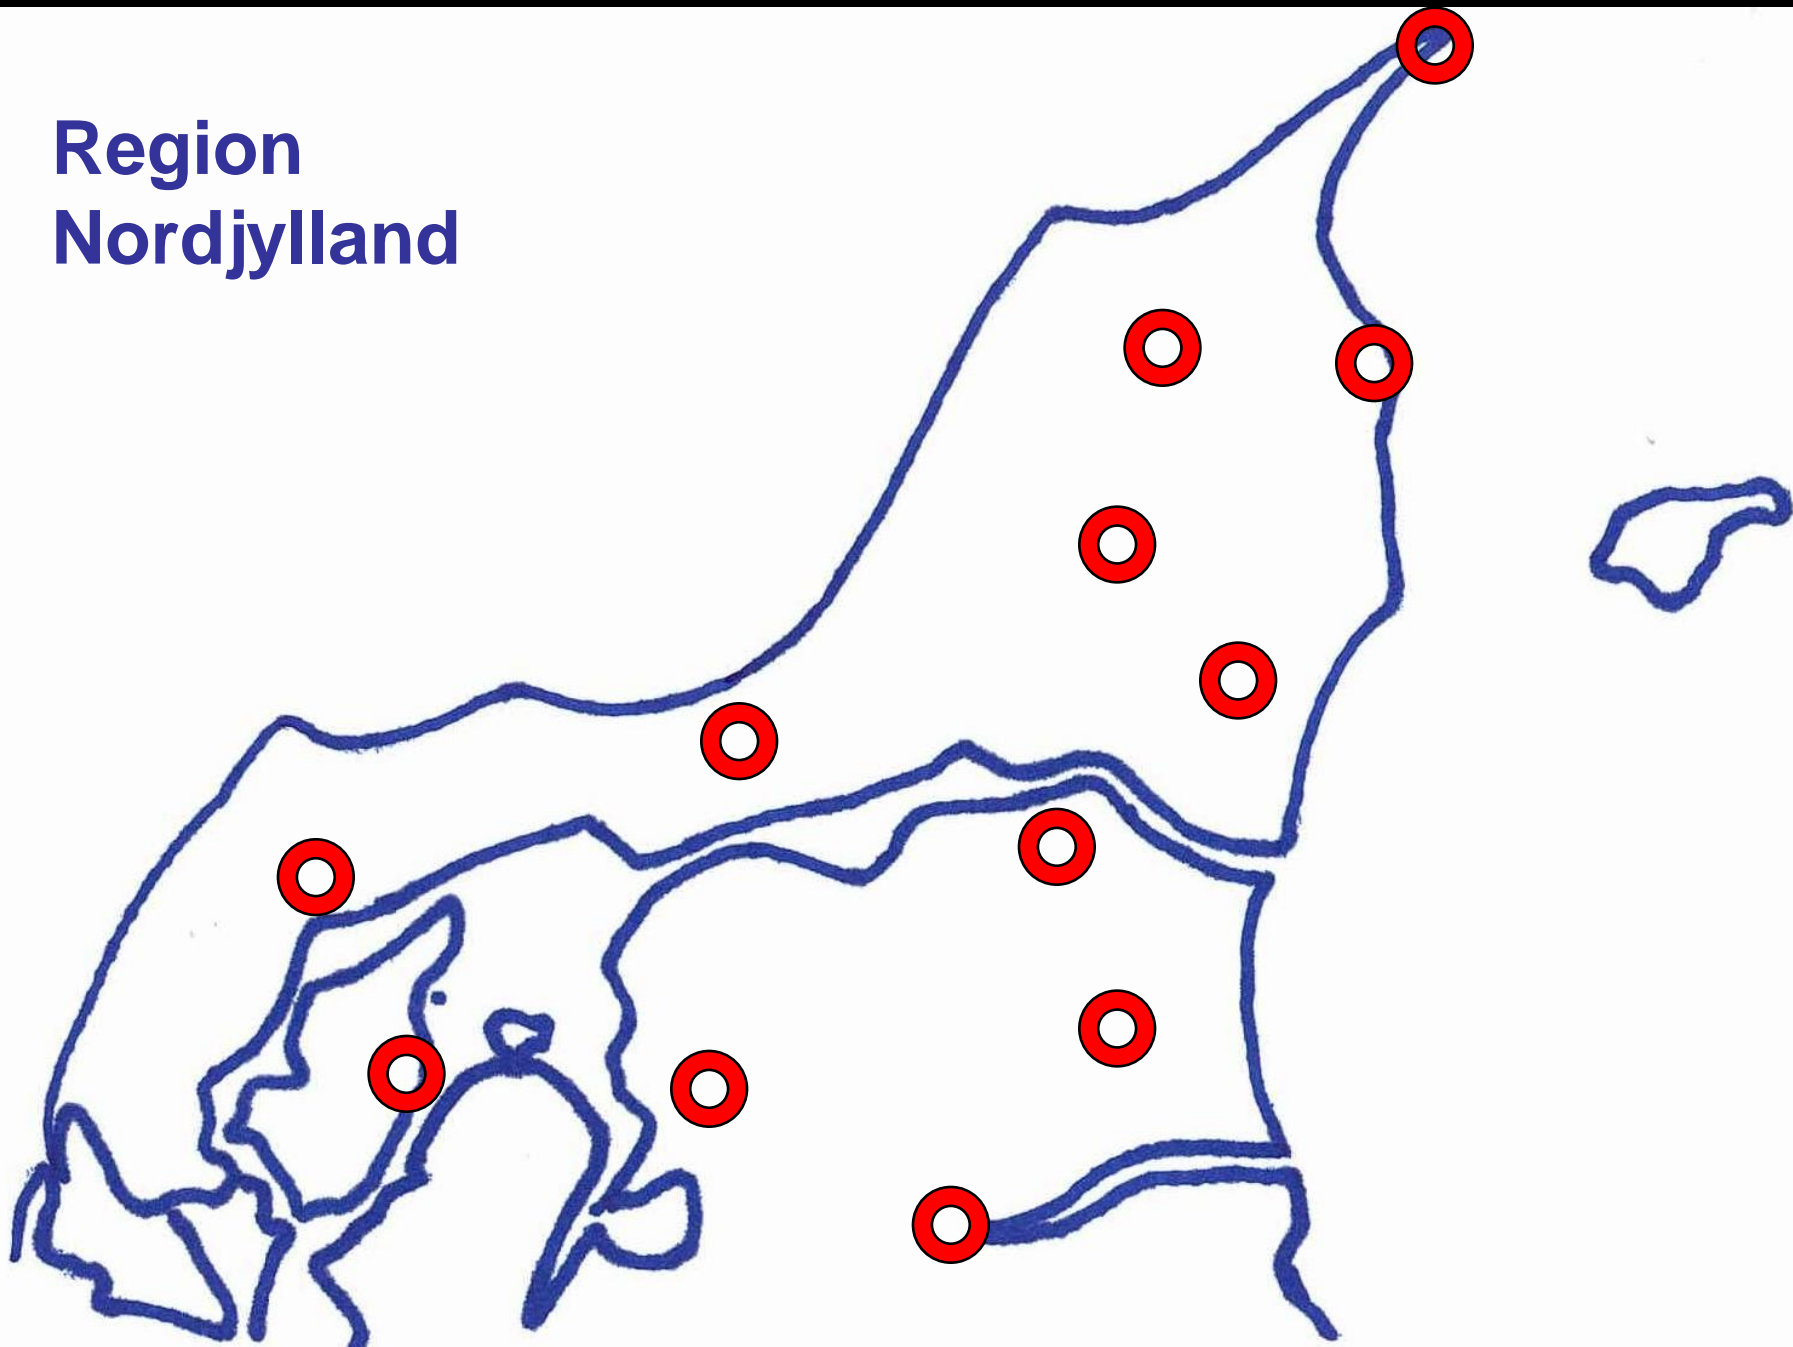


**Region
Nordjylland**

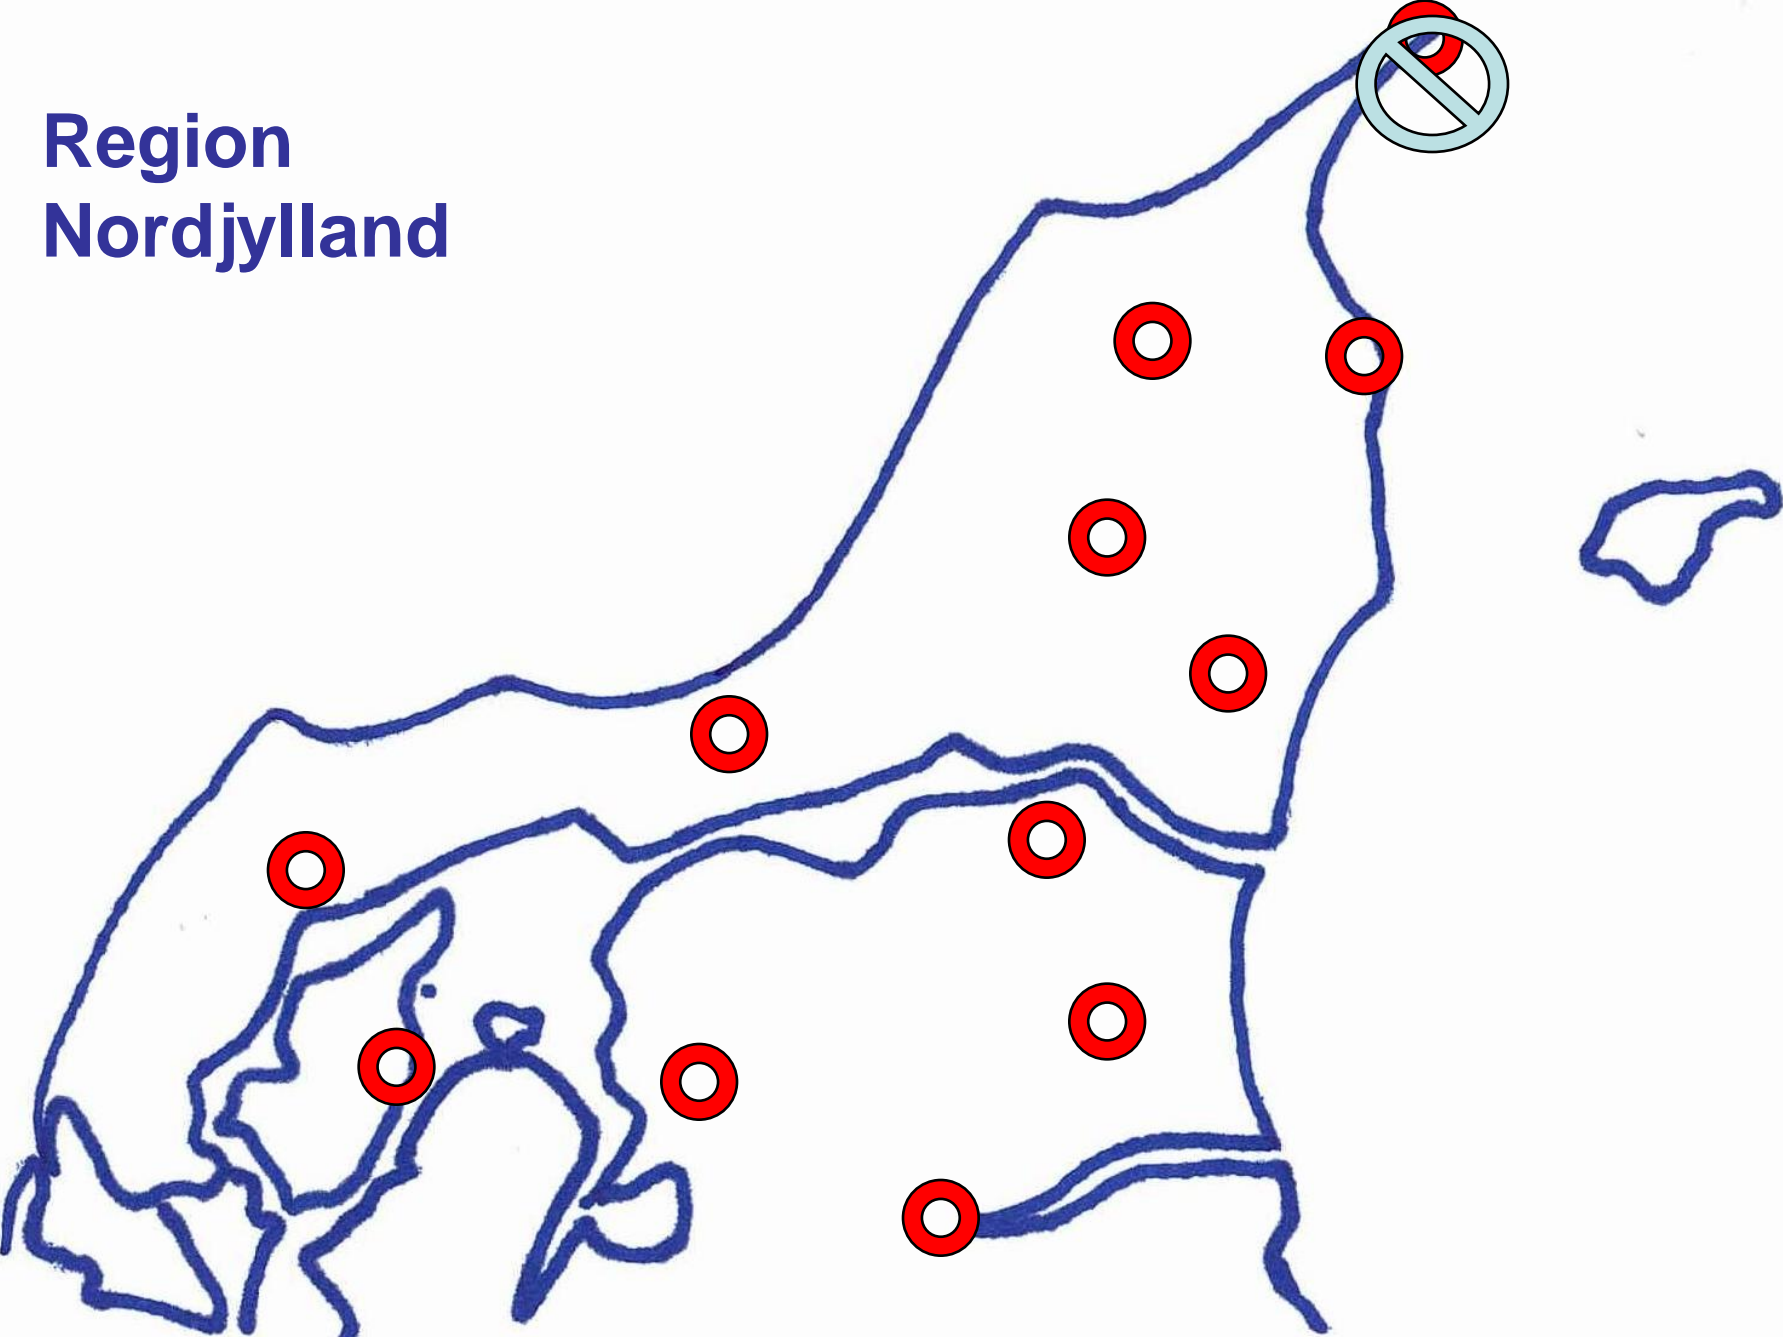


Region Nordjylland

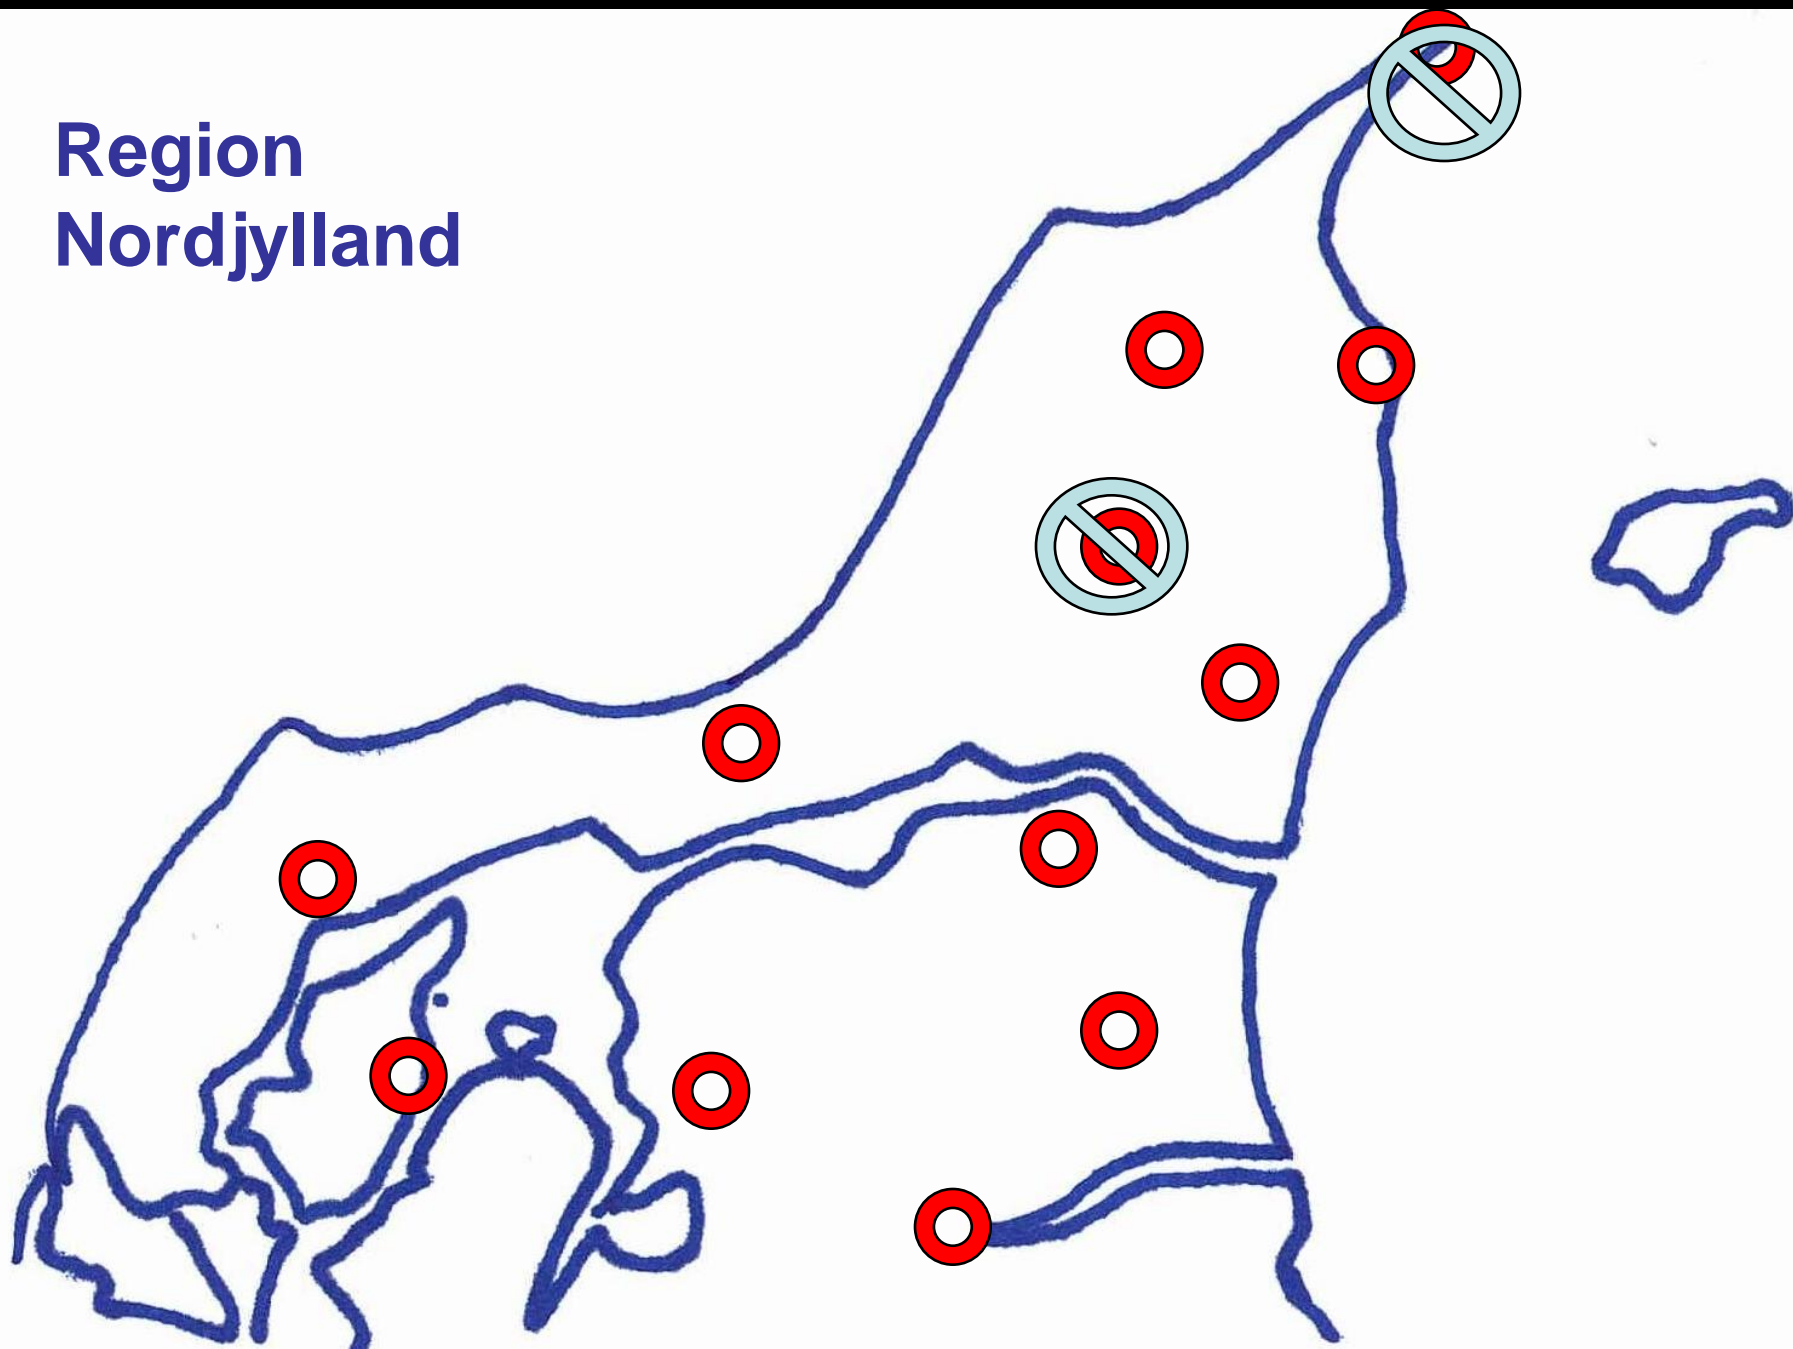


Region Nordjylland

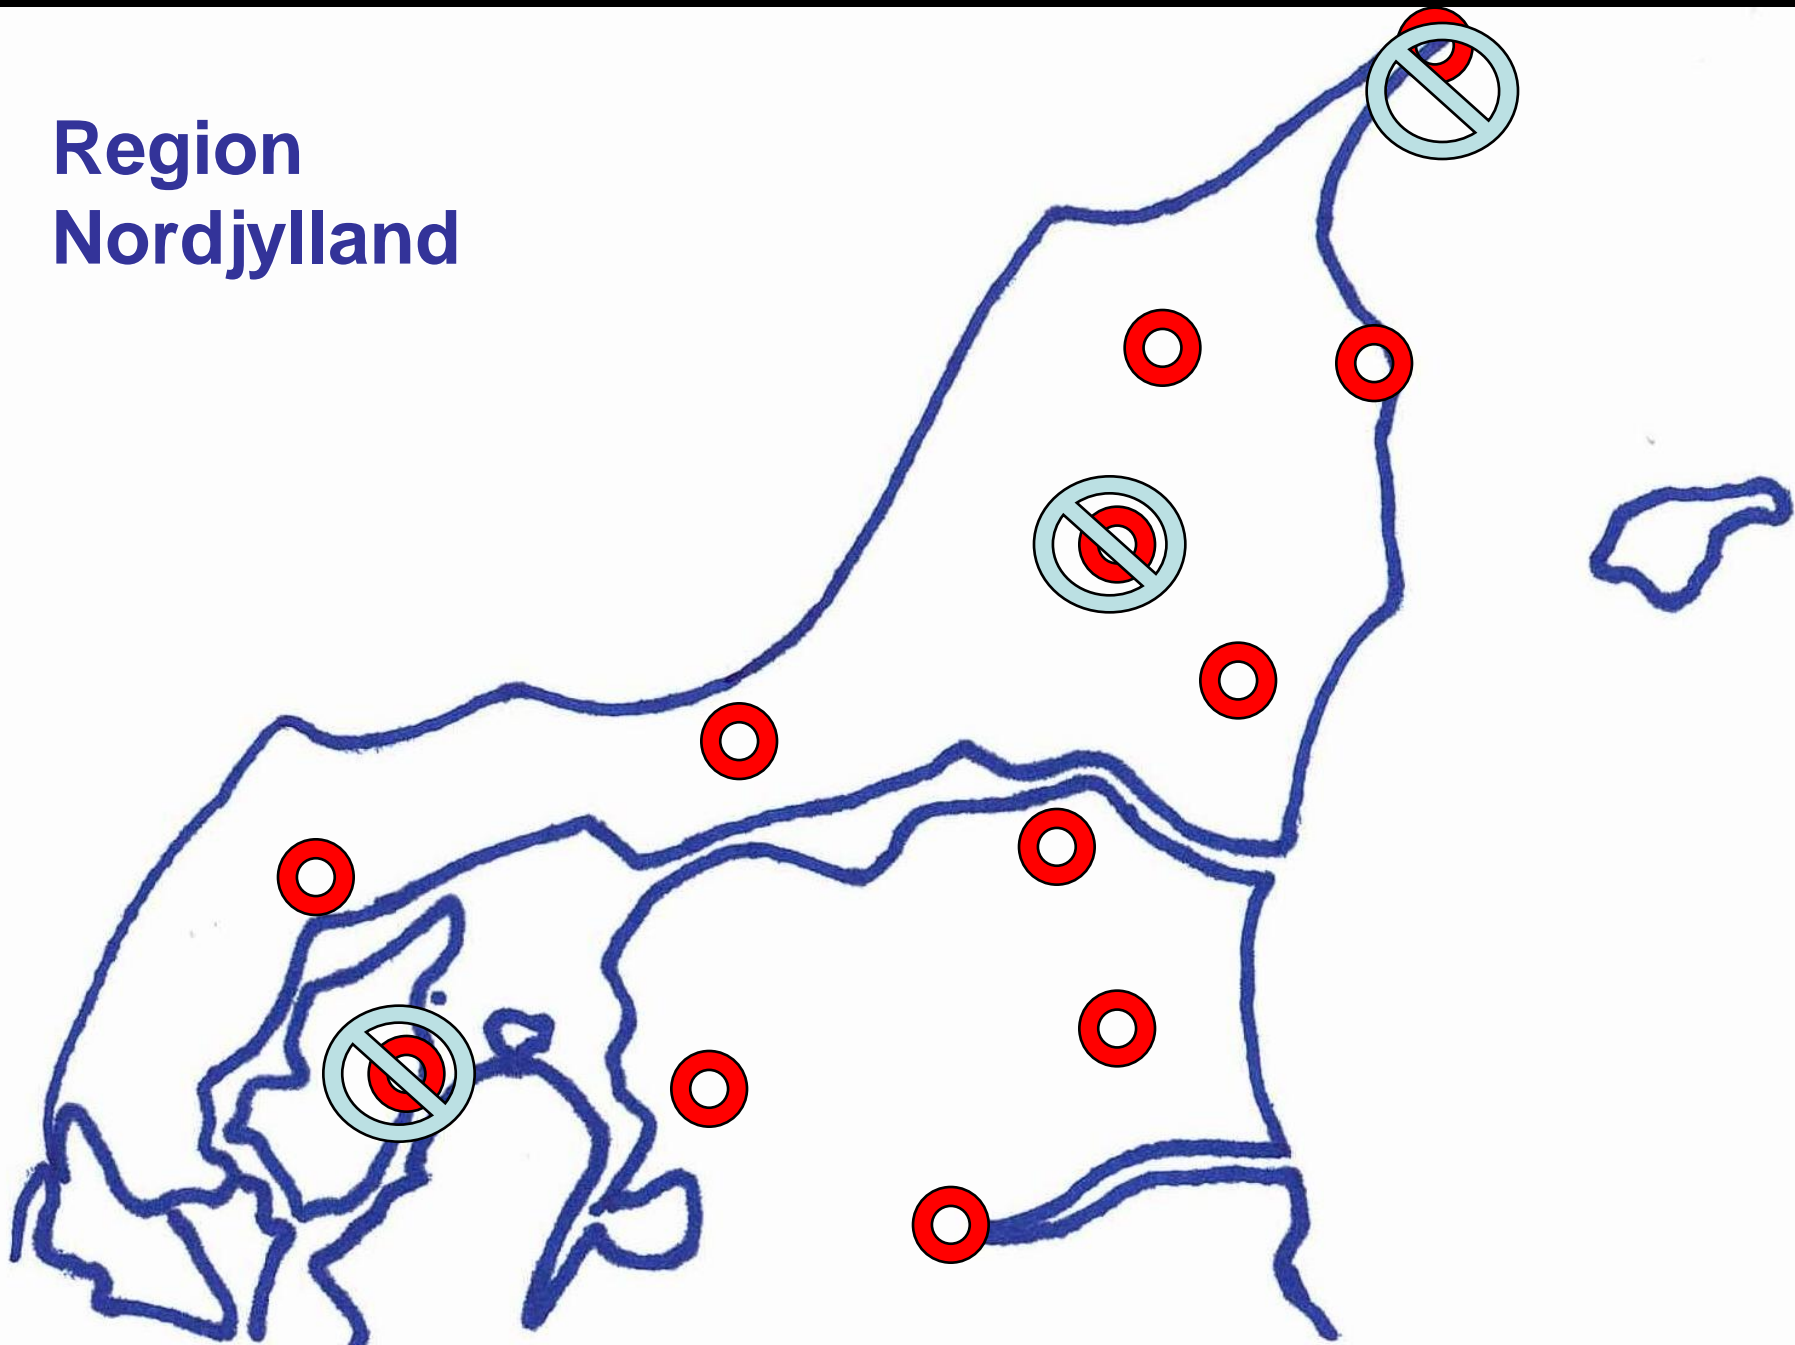


Region Nordjylland

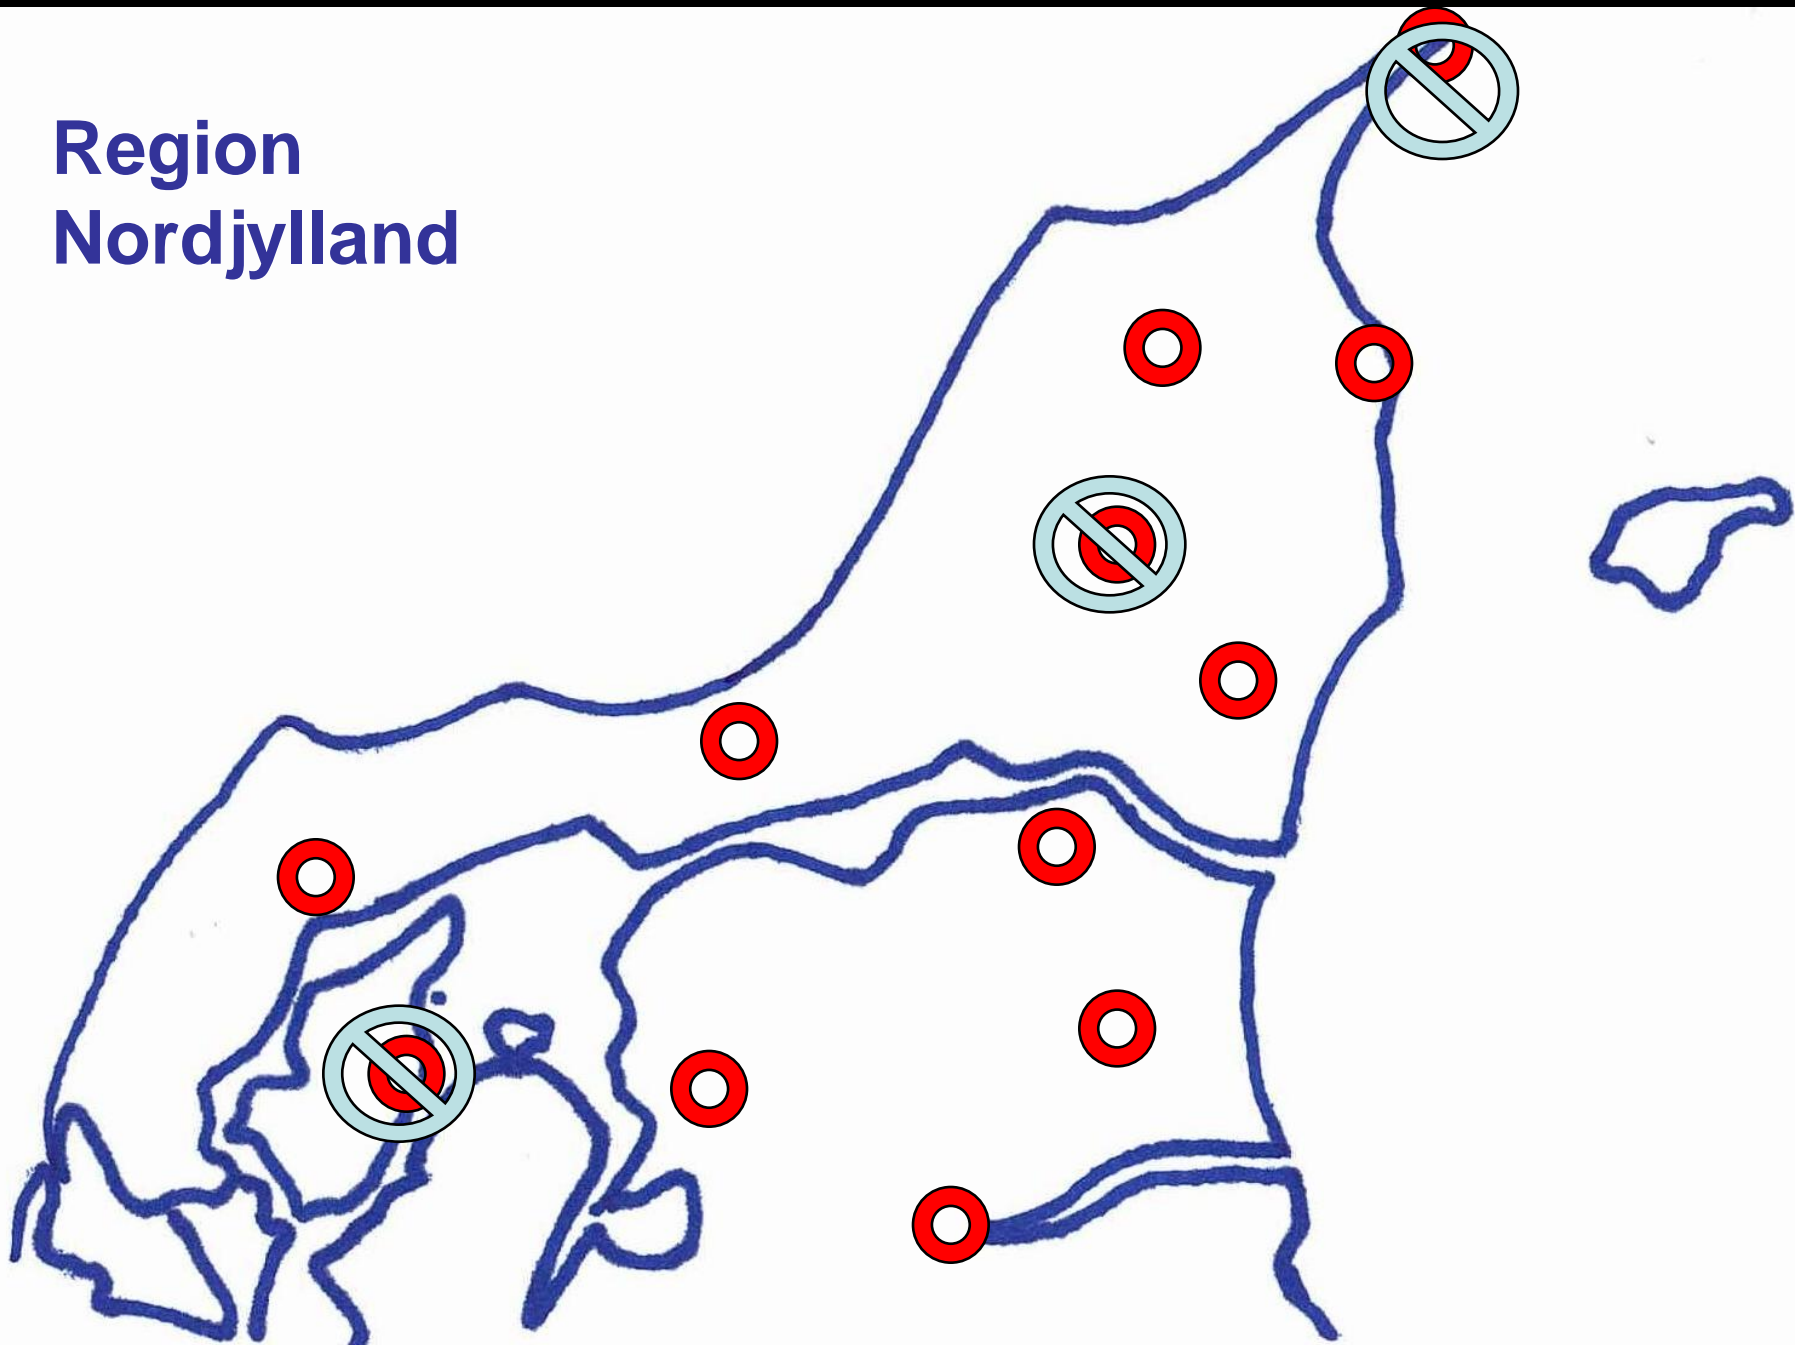


**Region
Nordjylland**

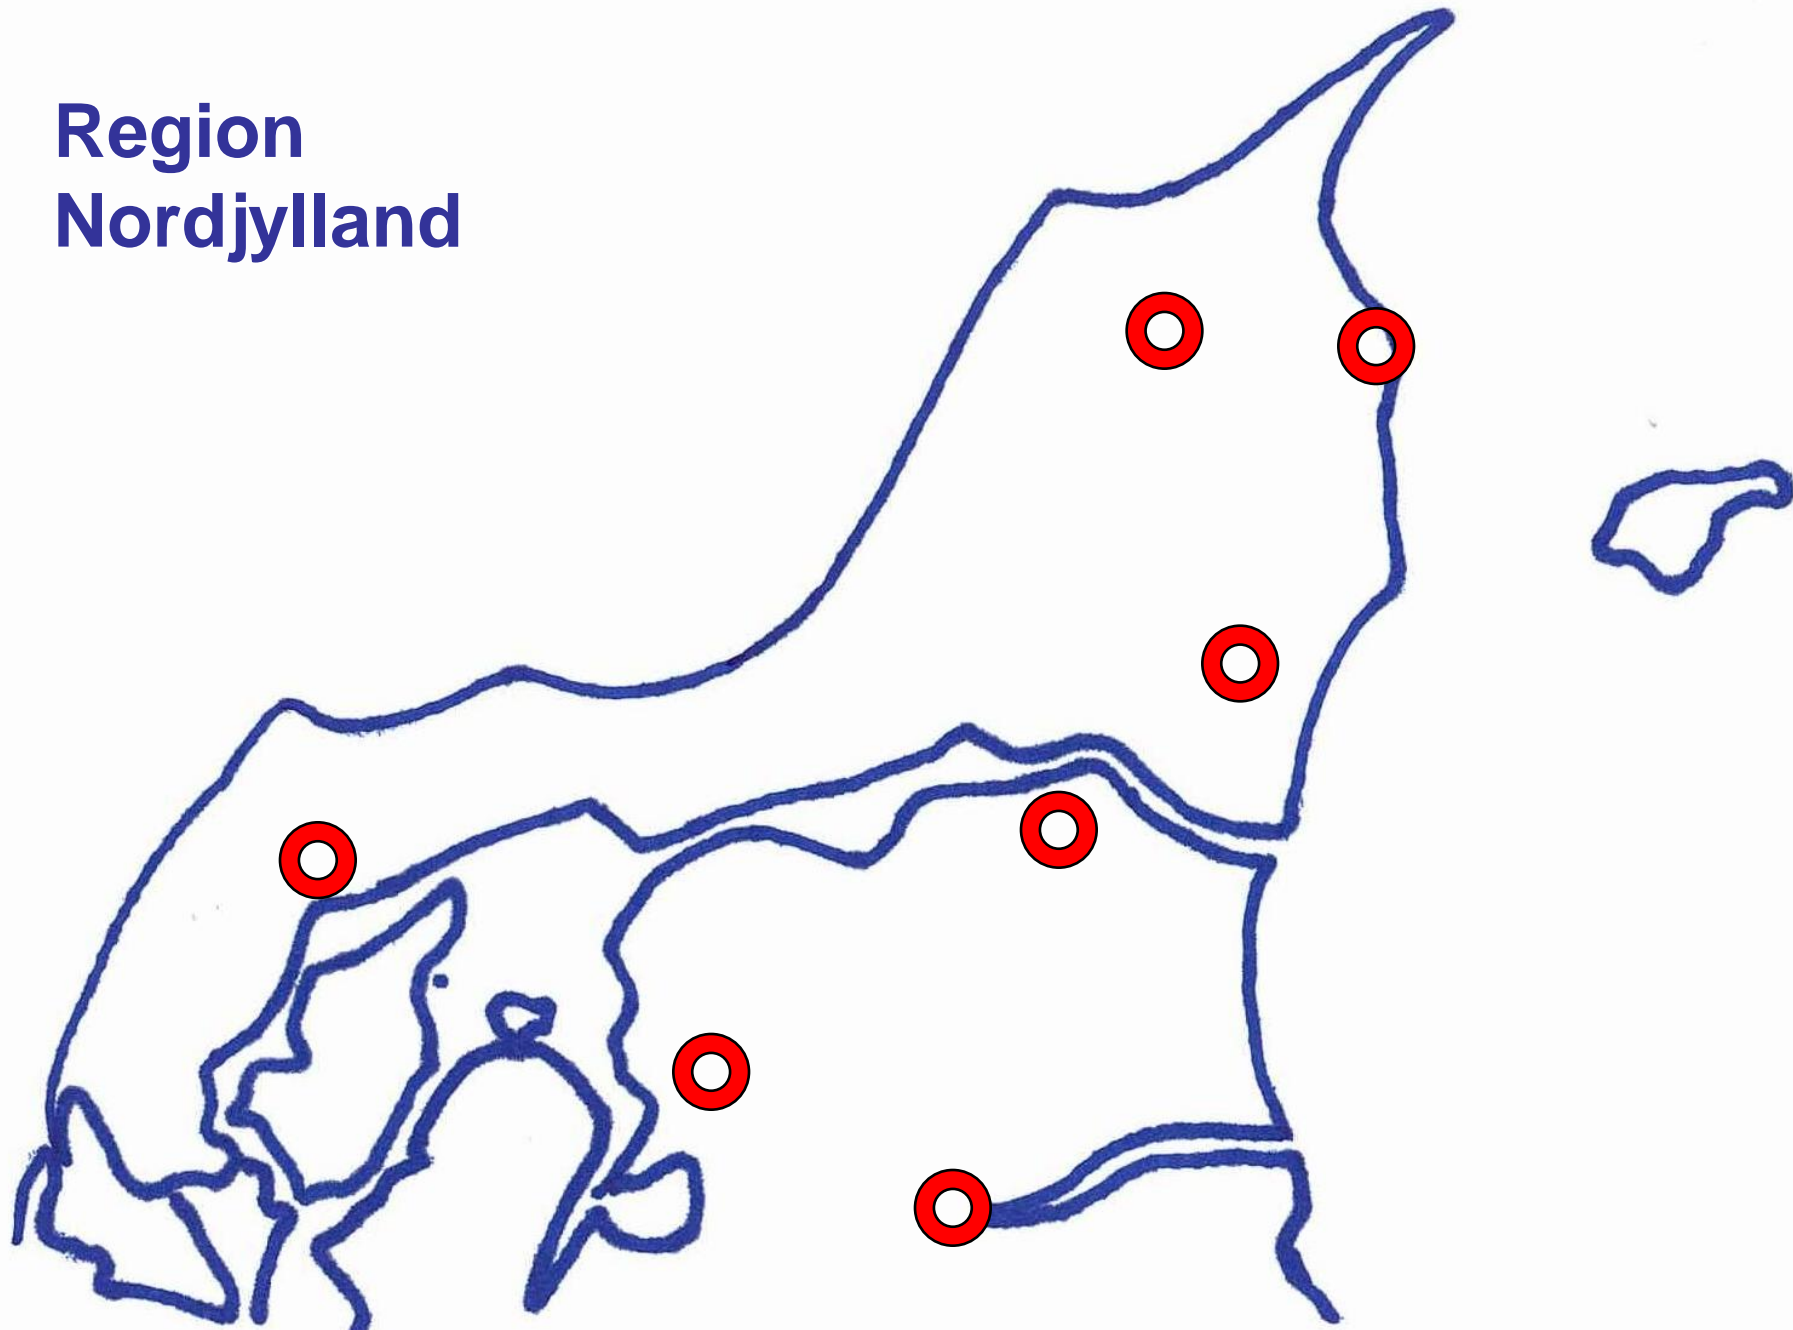


Region Nordjylland

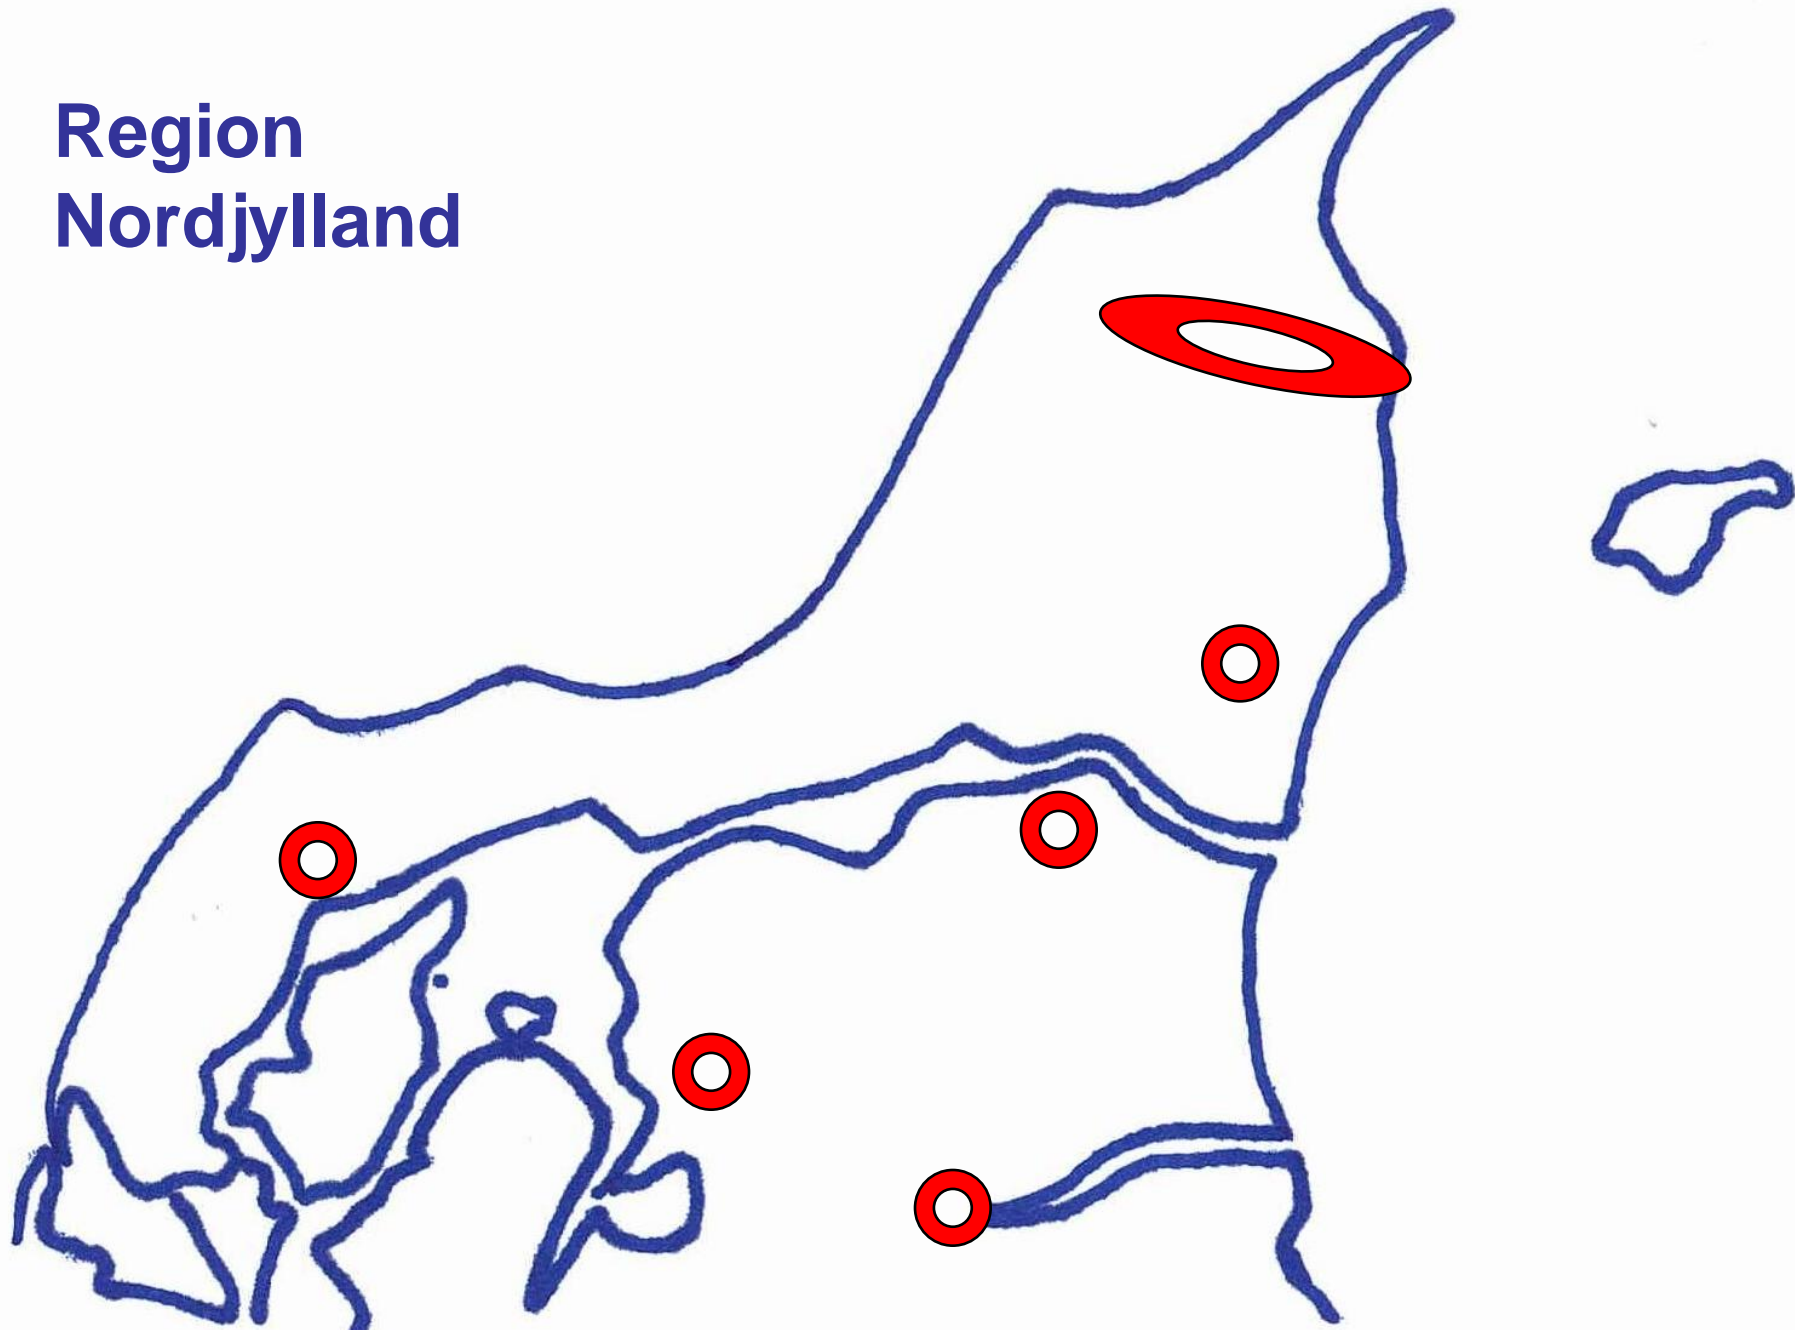


**Region
Nordjylland**

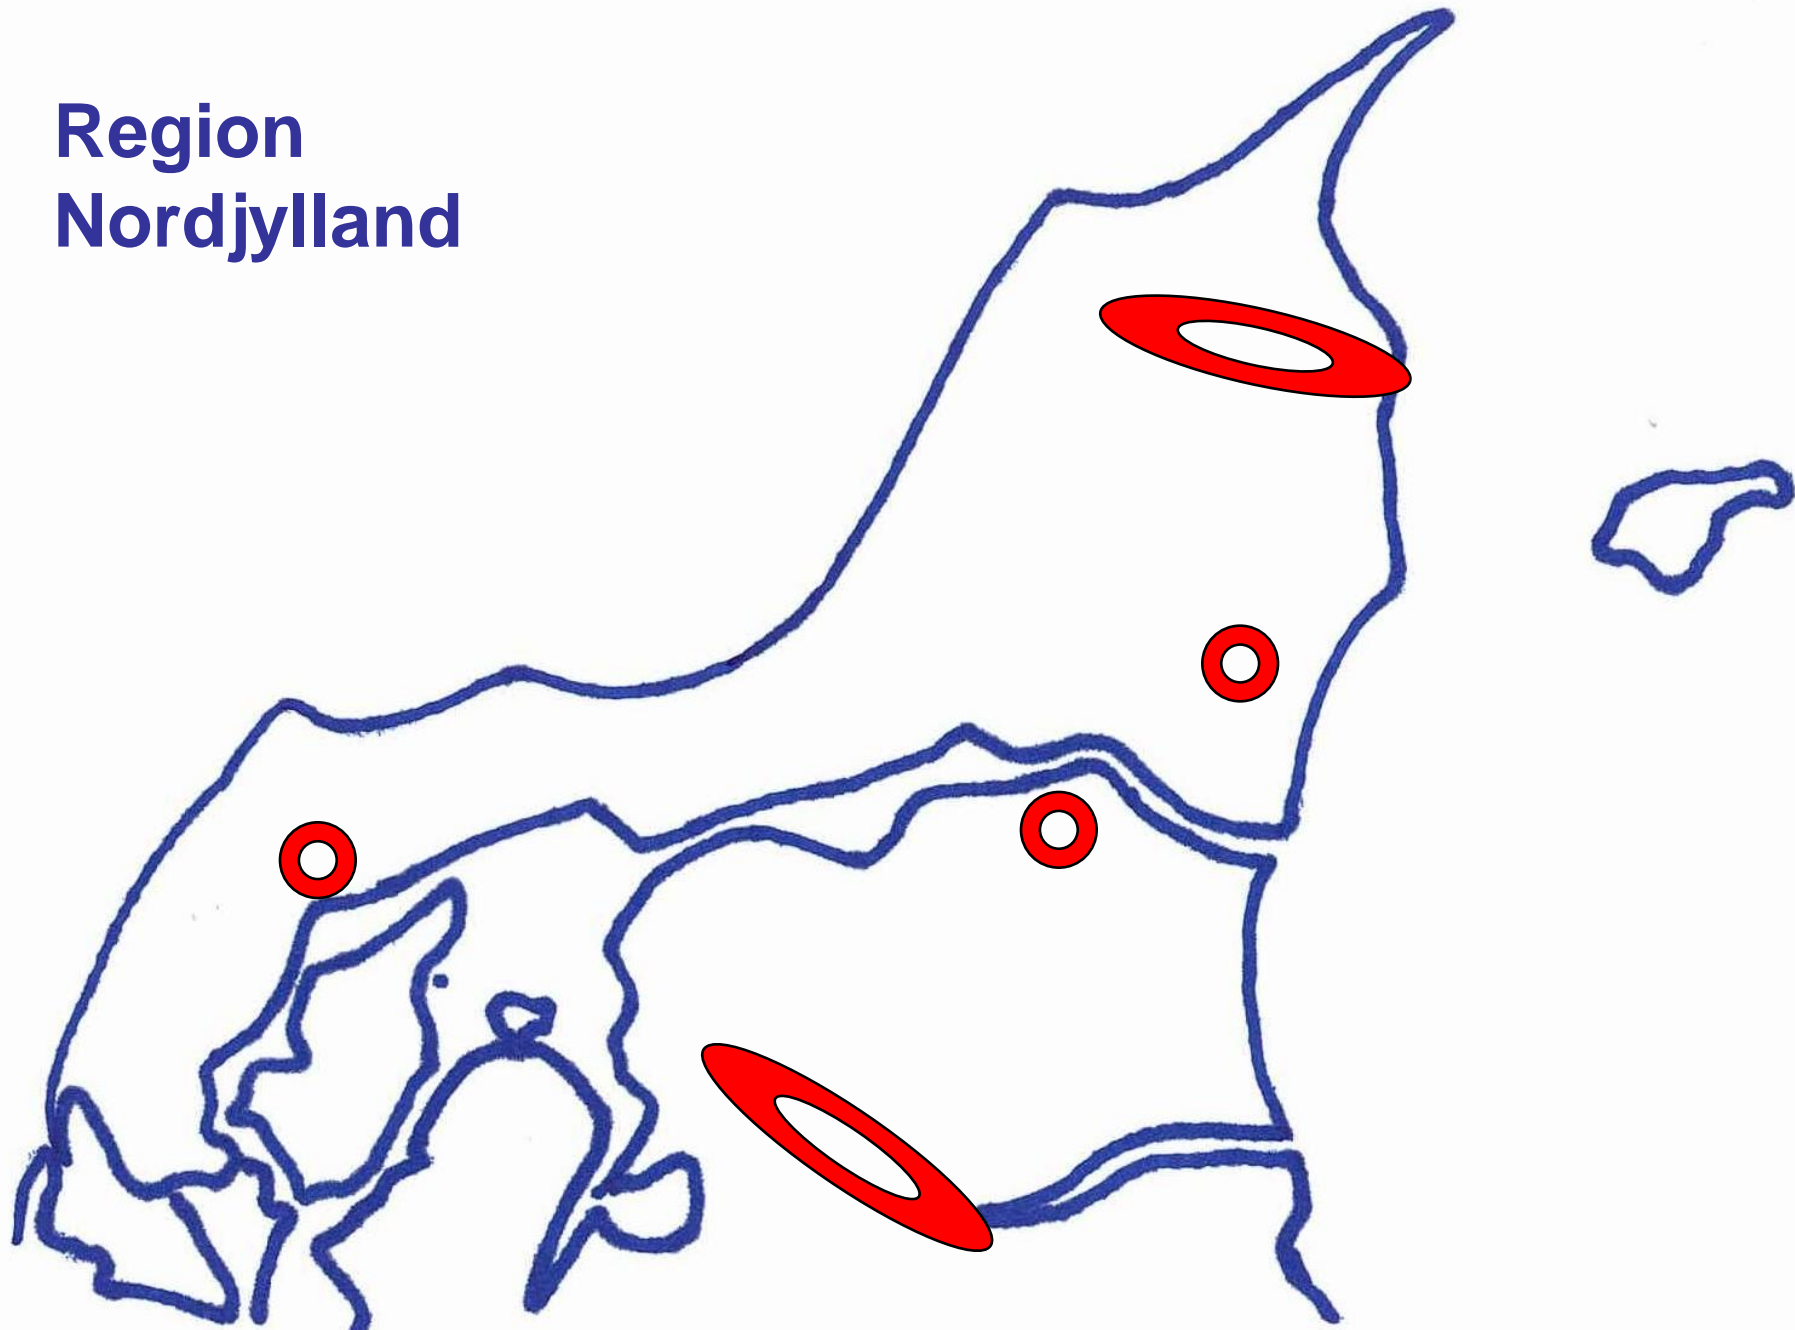

**Region
Nordjylland**

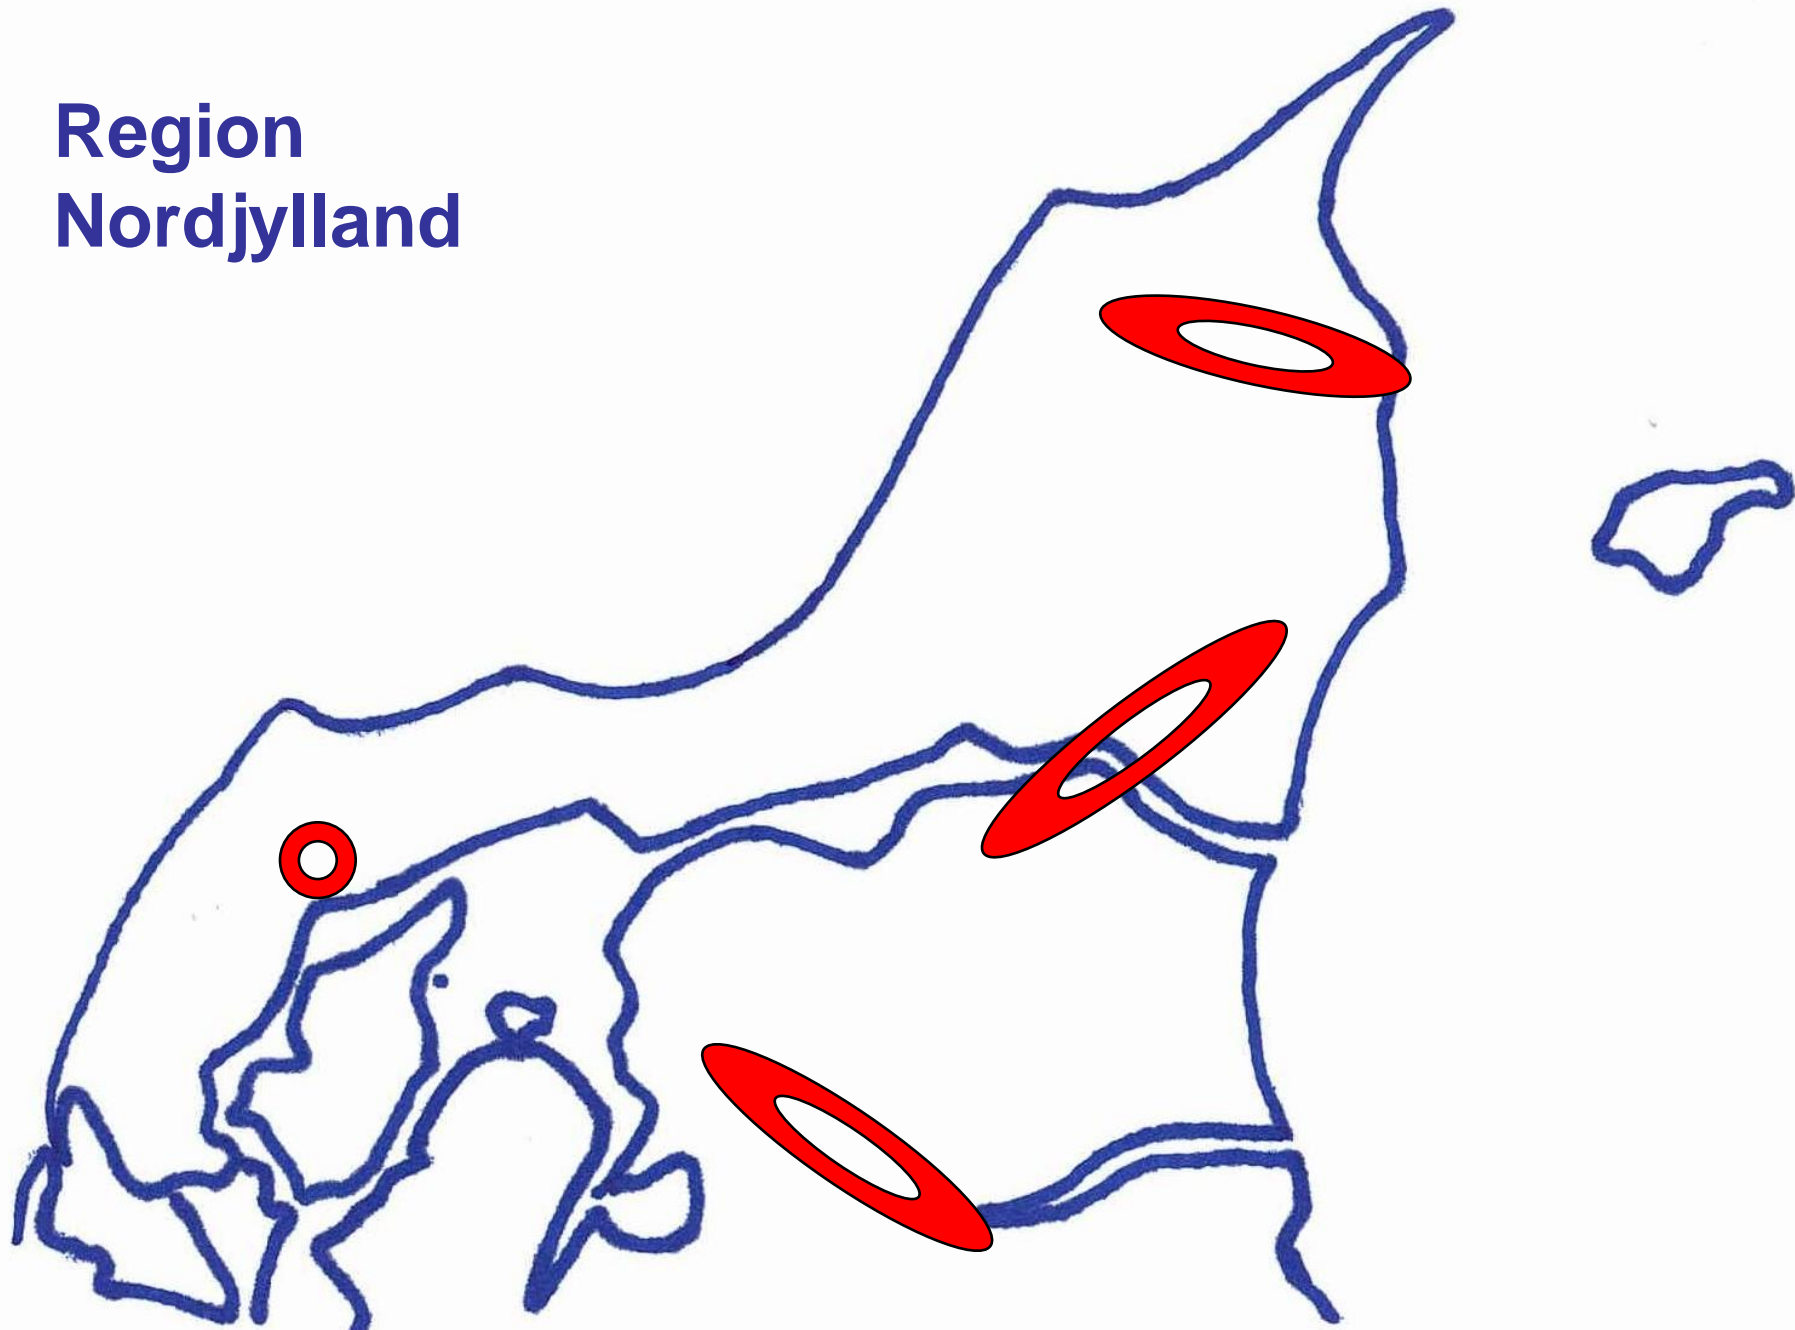

**Region
Nordjylland**

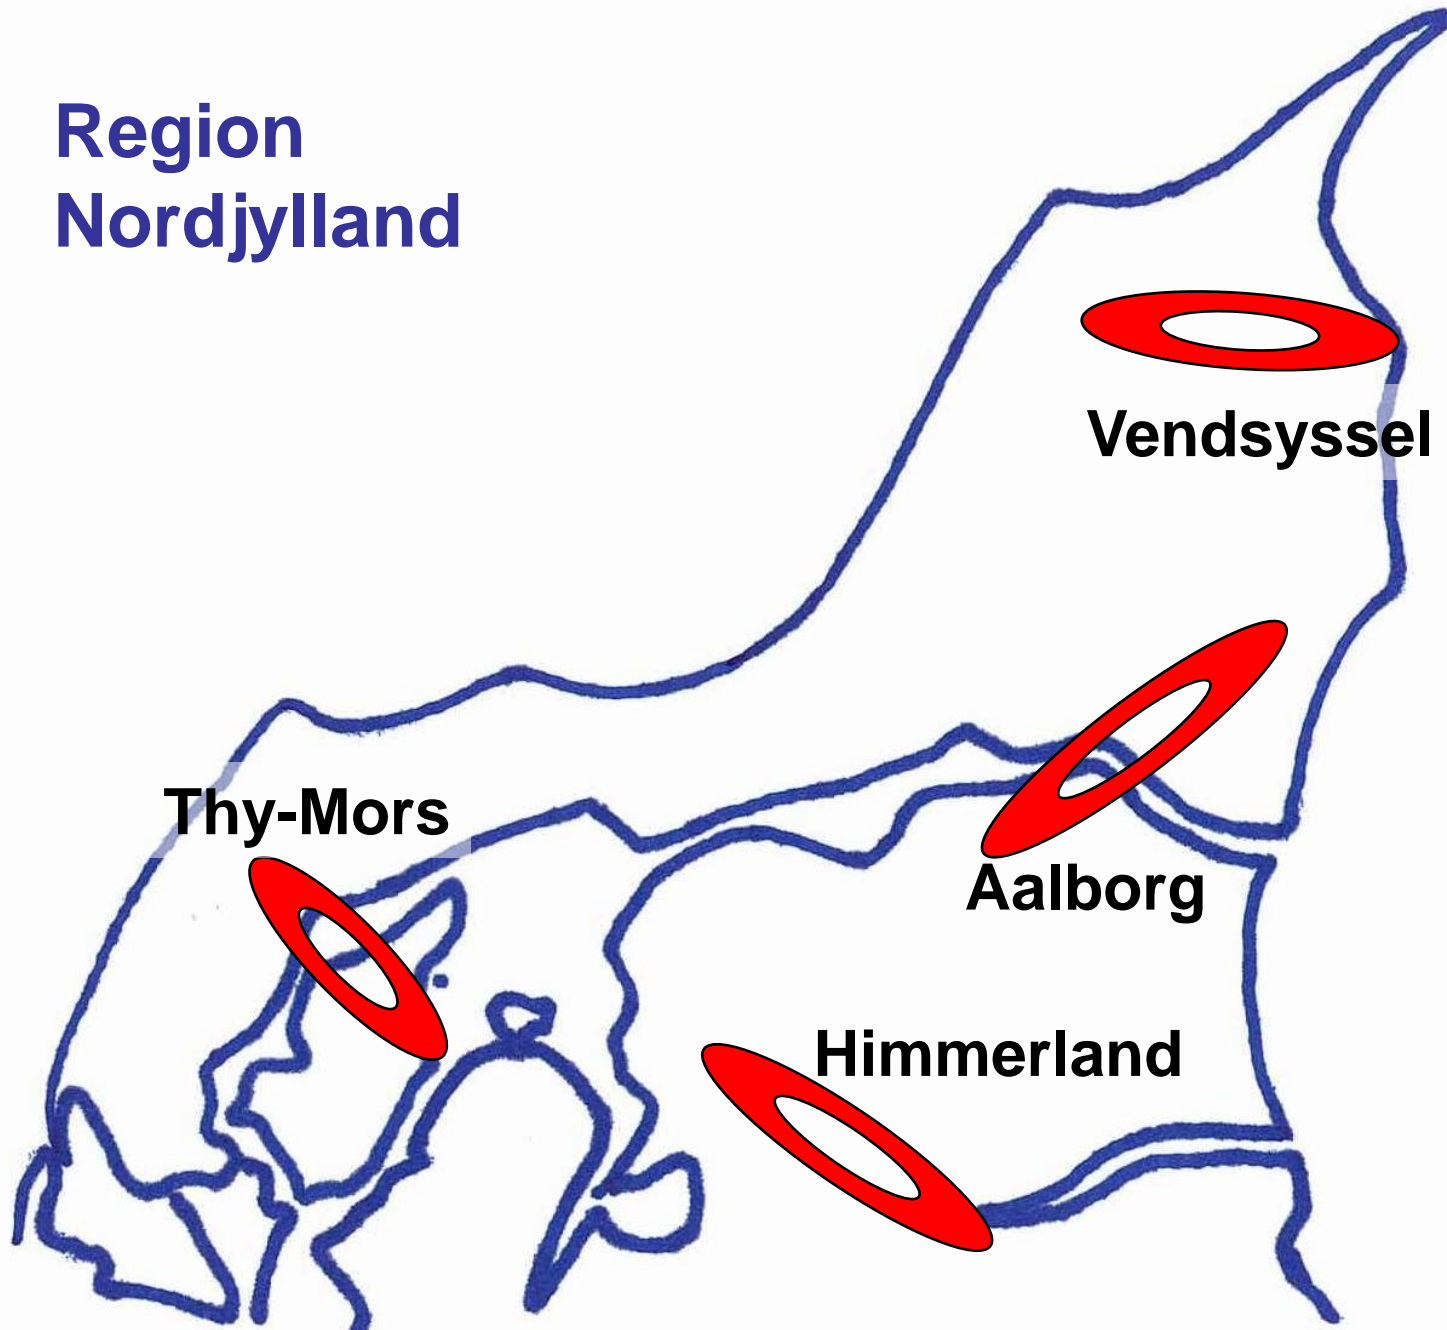


Vendsyssel

Thy-Mors

Aalborg

Himmerland



Region Nordjylland



4+2 medicoteknikere

Vendsyssel


Thy-Mors

Aalborg


Himmerland

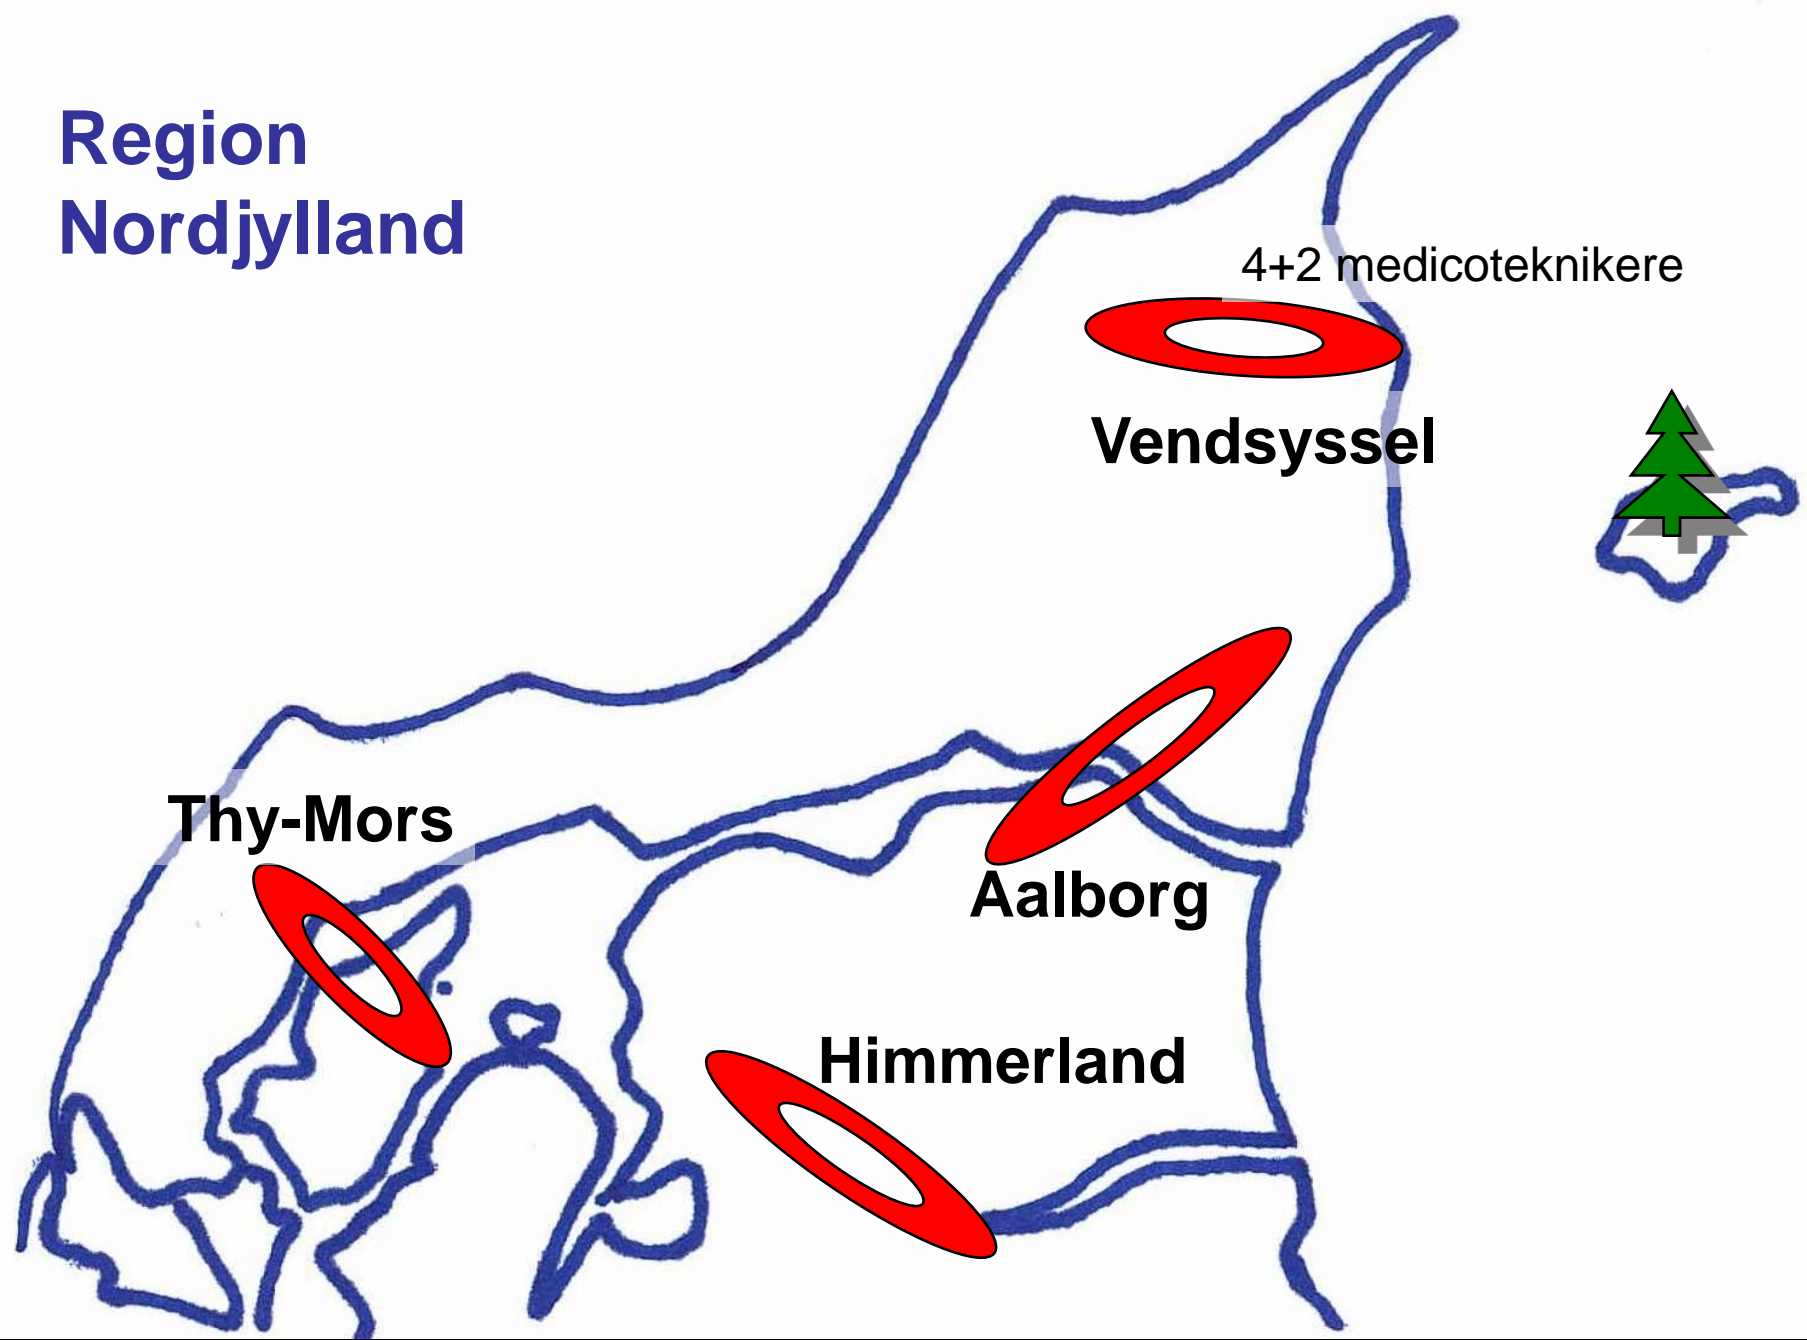

Region Nordjylland

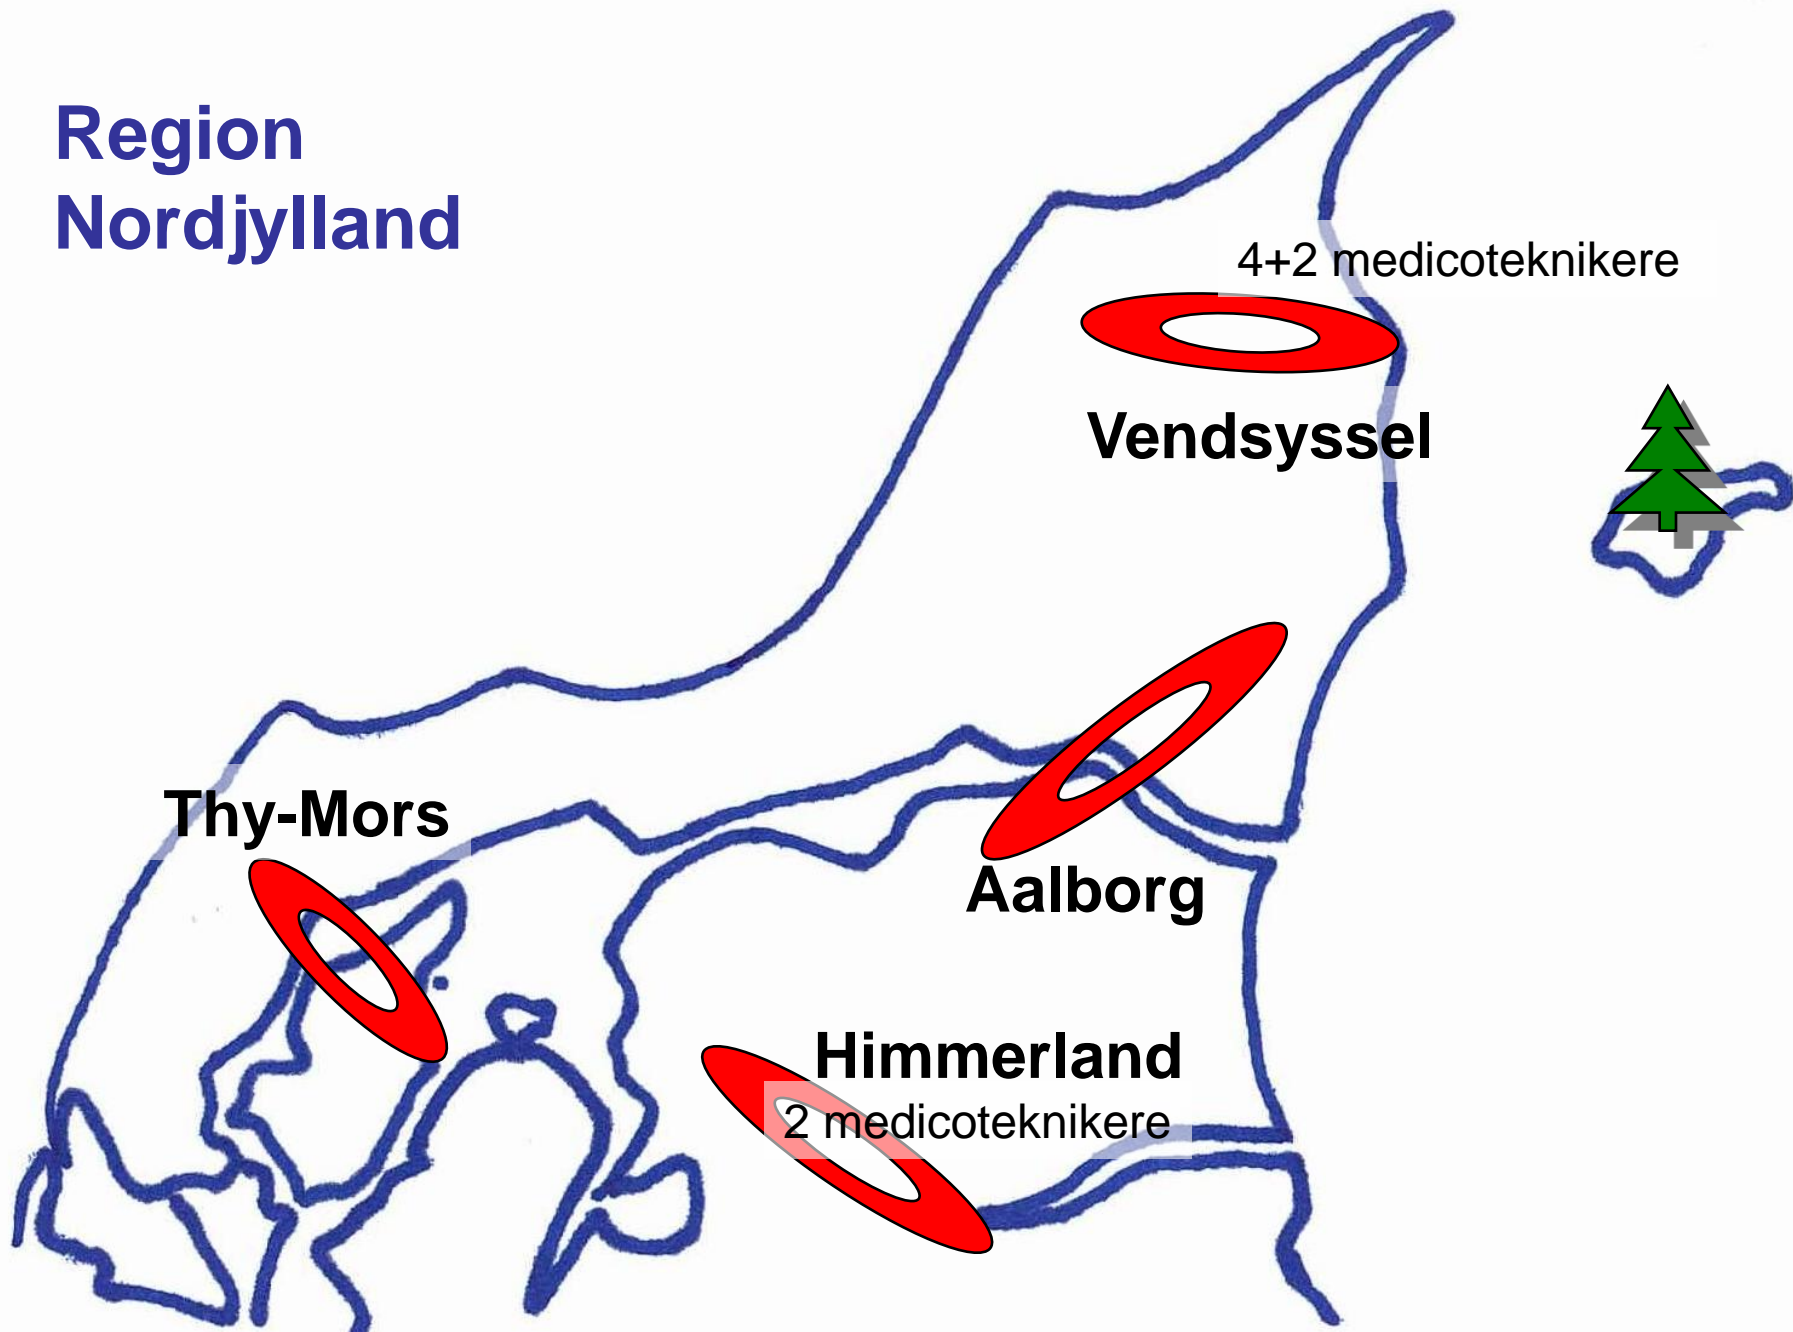

Region Nordjylland

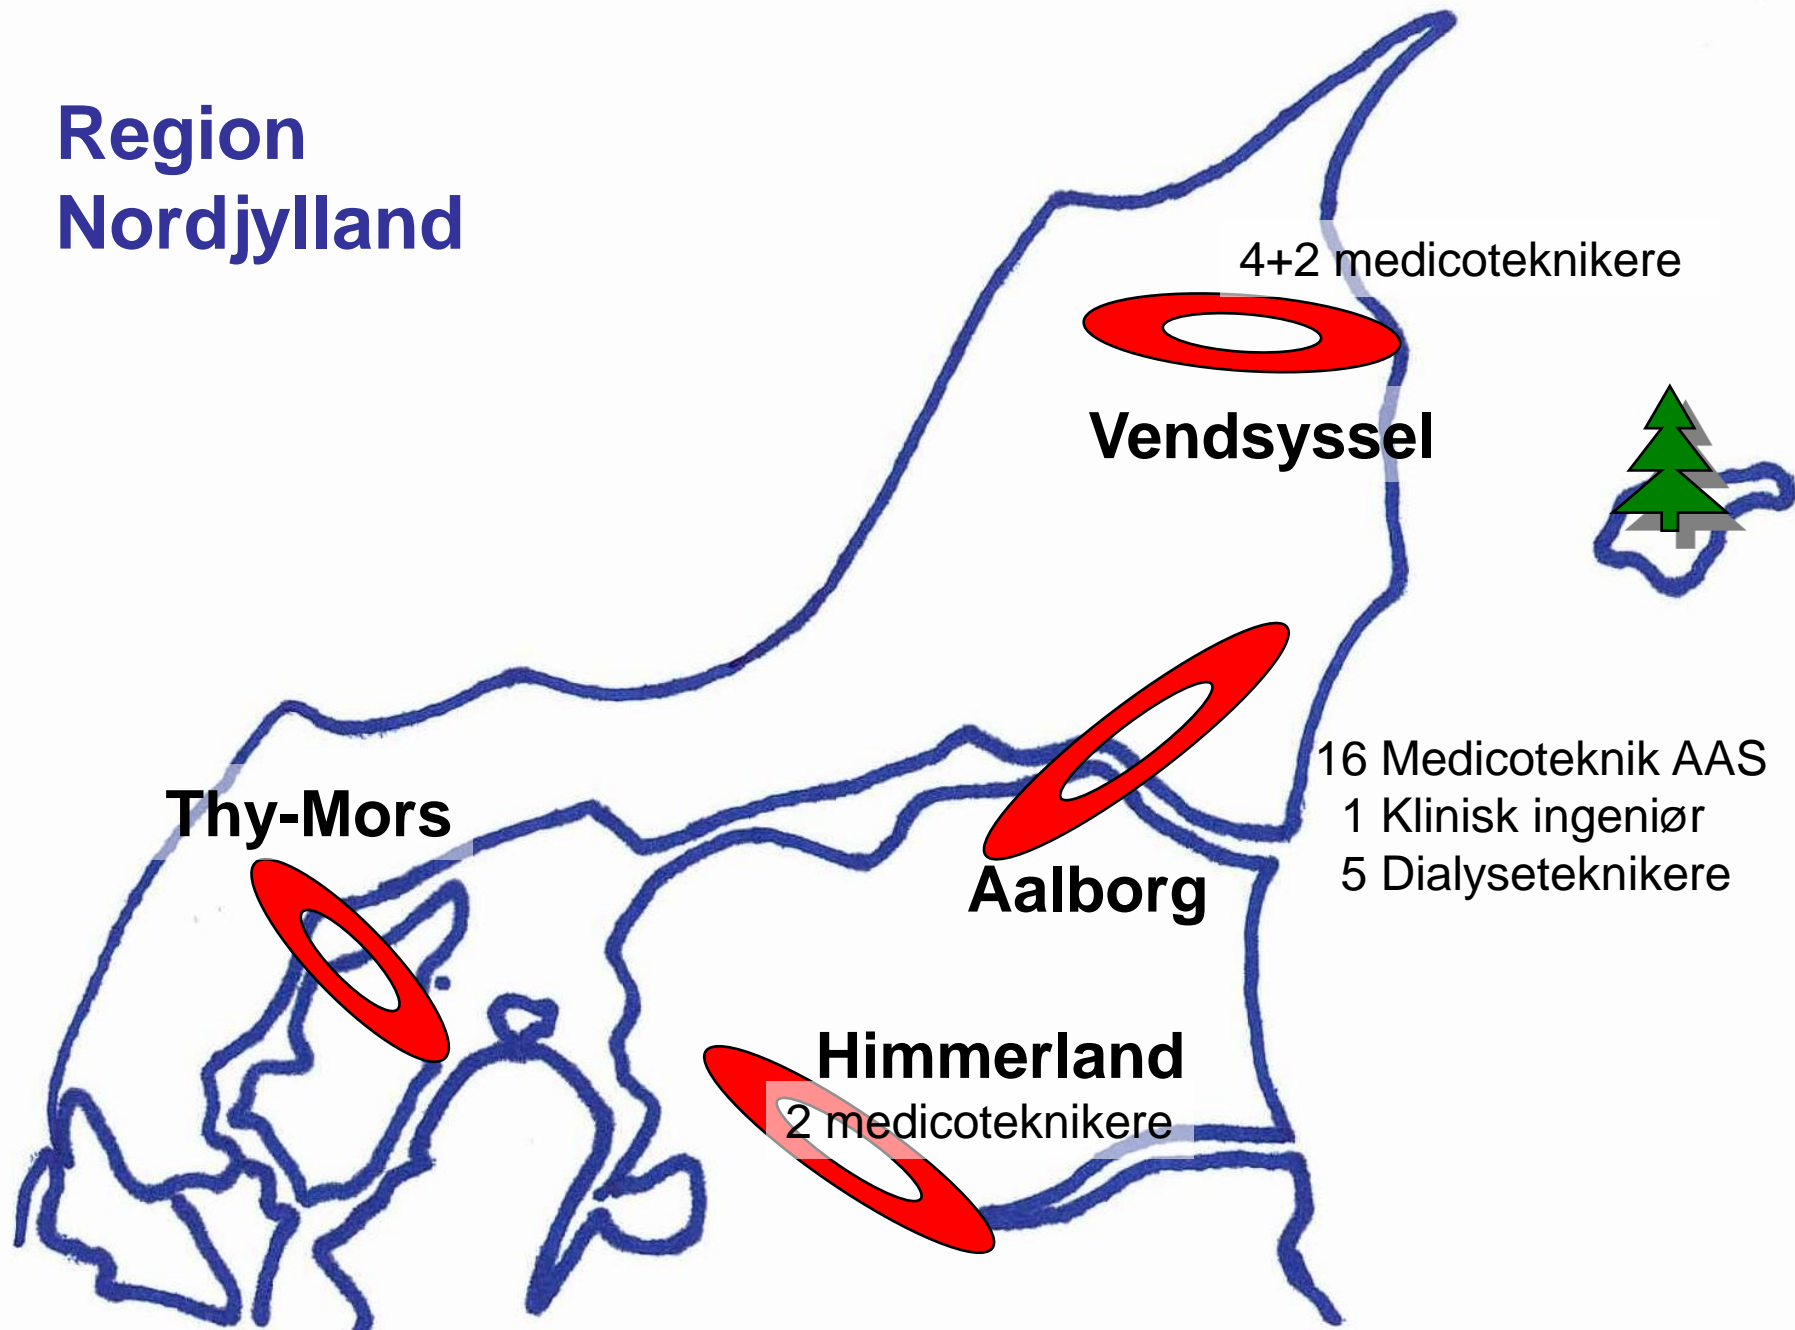

4+2 medicoteknikere

Vendsyssel

Thy-Mors


Aalborg

16 Medicoteknik AAS
1 Klinisk ingeniør
5 Dialyseteknikere

Himmerland

2 medicoteknikere

Region Nordjylland

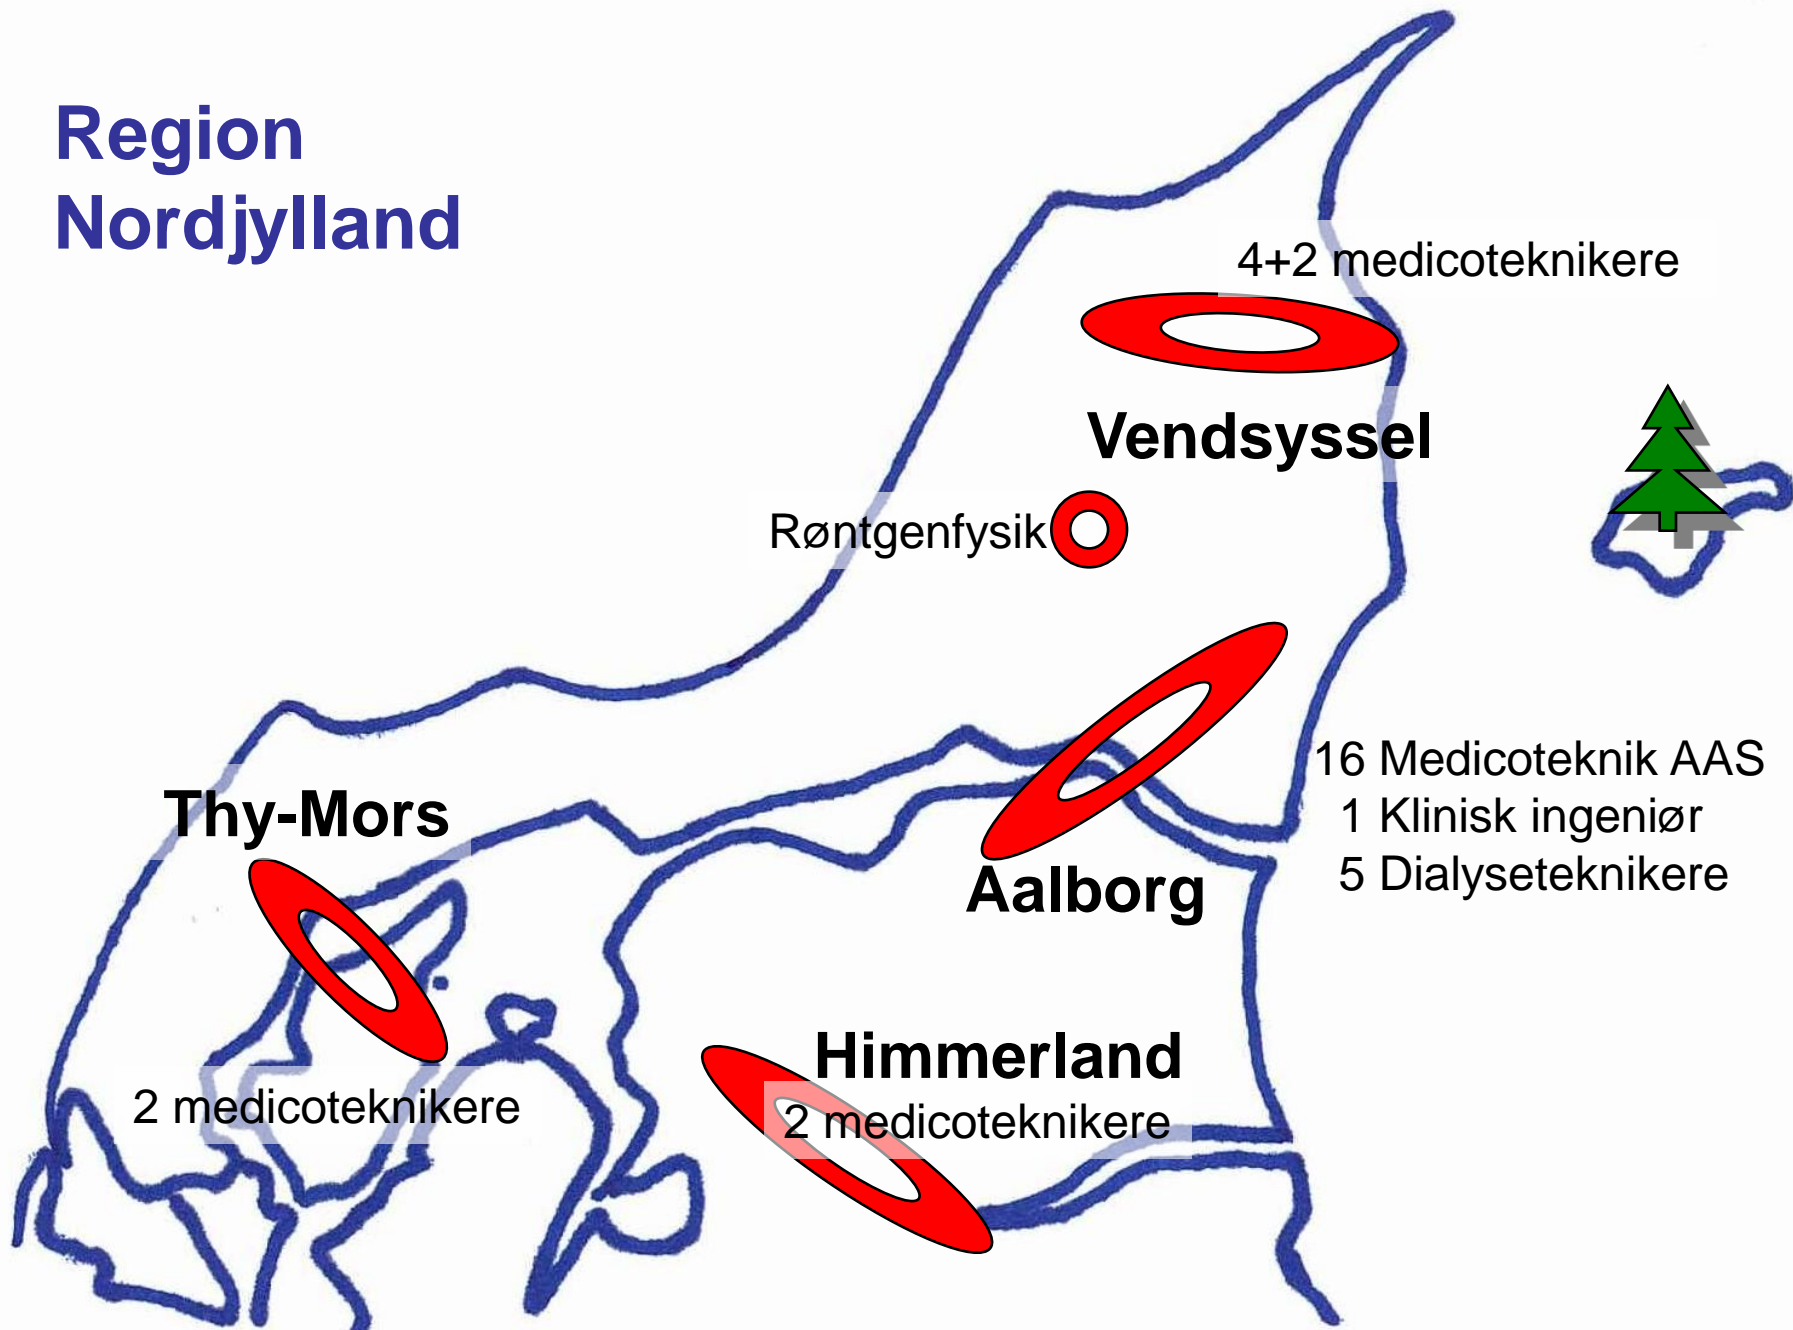

Fokus på vedligehold

- Gør vi det til tiden ?

NEXT TEST DUE

DATE

19.09.2007

ACTIONED / BY

HHP

Næste eftersyn
foretages ved:





MEDICOTEKNIK
AALBORG SYGEHUS

Næste eftersyn
foretages ved:



MEDICOTEKNIK
AALBORG SYGEHUS

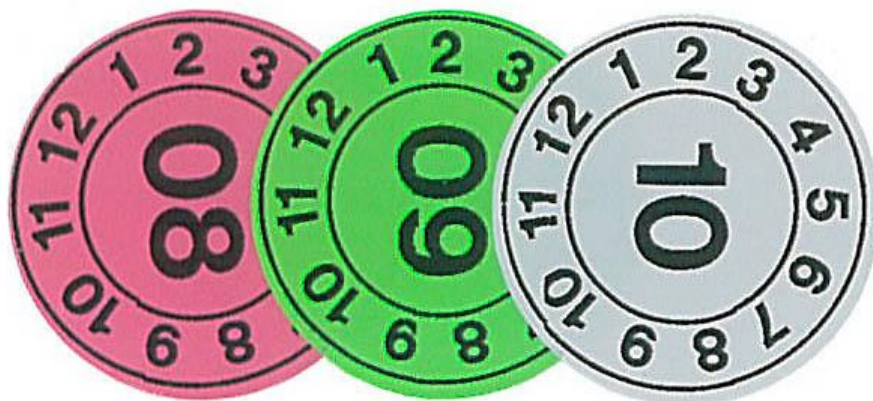

Næste eftersyn
foretages ved: 
MEDICOTEKNIK
AALBORG SYGEHUS



BIFASISK
200 JOULE MAKS

AFLEDN

STR.

STOP
ALARM

PRINT

MONITOR

OFF

PACE

OPLAD

▲
ENERGI
VALG
▼

1 DEFIB

2

3

CHK



TR HR

DEFEKT

Rekv.nr.:

Colleague
Volumetric Infusion

Baxter Healthcare Corporation
Medication Delivery Division
Deerfield, IL 60015 USA
Made in Singapore

PUT 100-120 / 220-240V-
50 Hz. 1.0 Amp

Region Nordjylland

